



NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Stefana kardynała Wyszyńskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa (Anin)
www.ikard.pl

tel.: +48 22 343 46 00

tel.: +48 22 815 30 11

fax: +48 22 343 45 25

Warszawa dnia: 2021-10-20

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ (1)

Na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), **Zamawiający** – Narodowy Instytut Kardiologii ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, dokonuje wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „ przetargu nieograniczonego” pn:

”Przebudowa budynku „F” Narodowego Instytutu Kardiologii wraz dostawą i montażem aparatury medycznej”

Znak sprawy: ZP.087.2021

1. Do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które udzielono następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wartości 1%, ma to uzasadnienie w niedawno powstałych przepisach oraz obecnej sytuacji po pandemicznej. Wspominanie obniżenie wpłynie zasadniczo na atrakcyjność składanych ofert oraz na ich liczebność co da możliwość Inwestorowi wyboru najkorzystniejszego wariantu do realizacji zamierzeń inwestycyjnych. W związku z powyższym prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wartości 1% i odpowiednio zmienia SWZ.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o informację czy w zakres dostawy wchodzi panele nadłóżkowe opisane w dokumencie Program Funkcjonalno-Użytkowy?

Odpowiedź:

Tak. Panele nadłóżkowe opisane w dokumencie - Program Funkcjonalno-Użytkowy, wchodzi w zakres dostawy i montażu Wykonawcy.

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o informację czy w zakres dostawy wchodzi myjnie chirurgiczne?

Jeśli tak prosimy o udostępnienie opisu technicznego i wskazanie ilości jaką należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

Dostawa i montaż myjni chirurgicznych jest po stronie Zamawiającego. Wykonawca ma wykonać zasilanie wody ciepłej i zimnej, odpływy do kanalizacji oraz zasilanie elektryczne 230 V. Myjnie będą wykonane jako trzystanowiskowe. Wykonawca ma obowiązek wpuszczenia na teren budowy firm wykonujących dostawę i instalację wyposażenia na zlecenie Zamawiającego, bez dodatkowych opłat.

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o informację czy w zakres dostawy wchodzi myjnia narzędzi?

Jeśli tak prosimy o udostępnienie opisu technicznego i wskazanie ilości jaką należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

Dostawa i montaż myjni po stronie Zamawiającego. Wykonawca ma wykonać zasilanie w wodę, odpływ kanalizacyjny, zasilanie elektryczne.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o informację czy w zakres dostawy wchodzi szafki szatniowe?

Jeśli tak prosimy o udostępnienie opisu technicznego i wskazanie ilości jaką należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

Dostawa i montaż szafek ubraniowych po stronie zamawiającego.

Pytanie 6

Prosimy Zamawiającego o informację czy w zakres dostawy wchodzi lada w pomieszczeniu rejestracja?

Jeśli tak prosimy o udostępnienie opisu technicznego?

Odpowiedź:

Dostawa i montaż lady po stronie Zamawiającego. Wykonawca wykona instalacje elektryczne i sieć komputerową do czterech stanowisk komputerowych. Instalacja ma być zabudowana wewnątrz konsoli, z podejściem do każdego stanowiska. Projekt technologii musi uwzględnić konsolę pielęgniarską na której zostaną ustawione cztery stanowiska komputerowe. Wykonawca ma obowiązek wpuszczenia na teren budowy firm wykonujących dostawę i instalację wyposażenia na zlecenie Zamawiającego, bez dodatkowych opłat.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem w dokumencie Program Funkcjonalno-Użytkowy wyposażenie meblowe np. stoły, krzesła, biurka, szafy, szafki, aneksy kuchenne itp. jest po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak. Wyposażenie meblowe np. stoły, krzesła, biurka, szafy, szafki, aneksy kuchenne itp. jest po stronie Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek wpuszczenia na teren budowy firm wykonujących dostawę i instalację wyposażenia na zlecenie Zamawiającego, bez dodatkowych opłat.

Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SIWZ KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA

Pytanie 8

Punkt 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumny anestezjologiczne wyposażone w układ hamulców realizowanych w sposób elektropneumatyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie techniczne, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 9

Punkt 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumny anestezjologiczne wyposażone w gniazdo odciągów gazów medycznych z automatycznym inżektorem wykorzystującym sprężone powietrze działającym w momencie podłączenia przewodu bez konieczności dodatkowego zasilania elektrycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie techniczne, ale nie będzie wymagał.

Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ KOLUMNA CHIRURGICZNO – PERFUZYJNA

Pytanie 10

Punkt 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumny chirurgiczno - perfuzyjne wyposażone w układ hamulców realizowanych w sposób elektropneumatyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie techniczne, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 11

Punkt 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumny chirurgiczno - perfuzyjne wyposażone w gniazdo odciągów gazów medycznych z automatycznym iniektorem wykorzystującym sprężone powietrze działającym w momencie podłączenia przewodu bez konieczności dodatkowego zasilania elektrycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie techniczne, ale nie będzie wymagał.

Dotyczy: Załącznik nr 2.5 do SWZ Lampa operacyjna z kamerą i monitorem**Pytanie 12**

Punkt 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw lampa z kamerą na jednym zawieszeniu gdzie kamera umieszczona jest w centralnym punkcie lampy i zawsze skierowana w środek pola operacyjnego oraz drugie zawieszenie do instalacji monitora?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika 2.5. pkt. 7 i nie dopuszcza zintegrowanej kamery z obudową czaszy lampy.

Pytanie 13

Punkt 10 i 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której czasza lampy zbudowana jest jako sześciokąt foremny z otworem w środku. Konstrukcja lamp zapewnia bardzo dobre parametry cyrkulacji powietrza nie wpływając na pracę nawiewu laminarnego oraz nie stwarza problemów podczas czyszczenia i dezynfekcji ponadto unikalny sposób zawieszenia czaszy na ramieniu daje nam możliwość bez wysiłkowego manewrowania czaszą. Dodatkowo uchwyt kardaniczny jest uchwytem brudnym przeznaczonym do pozycjonowania lampy przez personel pomocniczy. Dzięki temu rozwiązaniu proponowana przez nas lampa nie posiada dodatkowych uchwytów brudnych, dzięki czemu osiąga najlepsze warunki do współpracy z systemami nawiewów laminarnych (co jest potwierdzone przez spełnienie normy nr DIN:1946-4: 2008 Certyfikat dostosowania do nawiewu laminarnego). Minimalizacja turbulencji ma bezpośredni wpływ na utrzymanie sterylności w polu operacyjnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści kształty czaszy inne niż kołowe, jednocześnie Zamawiający wymaga aby lampa posiadała w swojej konstrukcji tzw. uchwyty „brudne”.

Pytanie 14

Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której uchwyt sterylny umieszczony jest centralnie w czaszy lampy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie techniczne, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 15

Punkt 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której temperatura barwowa regulowana jest w czterech krokach w zakresie 3500 do 5000K?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści szerszy zakres temperatury barwowej lampy niż wymagany, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 16

Punkt 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której czasza składa się z 72 diod LED?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie techniczne, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 17

Punkt 23

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną bez funkcji doświetlenia centralnej części pola oświetlanego? Oferowana lampa posiada wysokiej jakości parametry świetlne, a innowacyjna technologia LED sprawia że emitowane przez lampę światło o jednolitym wysokim natężeniu jest równomiernie dystrybuowane na całym oświetlanym polu tworząc jednorodny obszar roboczy zapobiegając zakłóceniom widoczności mogącym wystąpić przy nieregularnym oświetleniu wywołanym przez doświetlanie centrum pola.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania pkt. 23 załącznika 2.5.

Pytanie 18

Punkt 24

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której zakres regulacji średnicy pola operacyjnego wynosi 16 -25cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania pkt. 24 załącznika 2.5.

Pytanie 19

Punkt 29

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną bez wbudowanego wskaźnika laserowego umożliwiającego pozycjonowanie lampy względem pola operacyjnego? Oferowana lampa posiada mocno skupioną wiązkę światła, bez trudu umożliwiającą pozycjonowanie lampy względem pola operacyjnego. Wymagany parametr nie jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania lampy i nakierowania wiązki światła, a jedynie niweluje możliwość przedstawienia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści lampę bez wymaganej funkcjonalności opisanej w pkt. 29 załącznika 2.5.

Pytanie 20

Punkt 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której oświetlenie endoskopowe włączane jest z panelu sterowania lampy i wynosi 10% natężenia maksymalnego lampy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie techniczne, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 21

Punkt 33

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której istnieje możliwość transmisji obrazu ze sterownika kamery przez sieć LAN?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie techniczne, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 22

Punkt 34

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną wyposażoną w kamerę z ZOOMem optycznym x10?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg punktu 34 Załącznika nr 2.5.

Dotyczy: Załącznik nr 2.6 do SIWZ Lampa operacyjna

Pytanie 23

Punkt 9 i 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której czasza lampy zbudowana jest jako sześciokąt foremny z otworem w środku. Konstrukcja lamp zapewnia bardzo dobre parametry cyrkulacji powietrza nie wpływając na pracę nawiewu laminarnego oraz nie stwarza problemów podczas czyszczenia i dezynfekcji ponadto unikalny sposób zawieszenia czaszy na ramieniu daje nam możliwość bez wysiłkowego manewrowania czaszą. Dodatkowo uchwyt kardaniczny jest uchwytem brudnym przeznaczonym do pozycjonowania lampy przez personel pomocniczy. Dzięki temu rozwiązaniu proponowana przez nas lampa nie posiada dodatkowych uchwytów brudnych, dzięki czemu osiąga najlepsze warunki do współpracy z

systemami nawiewów laminarnych (co jest potwierdzone przez spełnienie normy nr DIN:1946-4: 2008 Certyfikat dostosowania do nawiewu laminarnego). Minimalizacja turbulencji ma bezpośredni wpływ na utrzymanie sterylności w polu operacyjnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści kształty czaszy inne niż kołowe, jednocześnie Zamawiający wymaga aby lampa posiadała w swojej konstrukcji tzw. uchwyty „brudne”.

Pytanie 24

Punkt 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której uchwyt sterylny umieszczony jest centralnie w czaszy lampy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie techniczne, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 25

Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której temperatura barwowa regulowana jest w czterech krokach w zakresie 3500 do 5000K?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści szerszy zakres temperatury barwowej lampy niż wymagany, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 26

Punkt 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której czasza składa się z 72 diod LED?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie techniczne, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 27

Punkt 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną bez funkcji doświetlenia centralnej części pola oświetlanego? Oferowana lampa posiada wysokiej jakości parametry świetlne, a innowacyjna technologia LED sprawia że emitowane przez lampę światło o jednolitym wysokim natężeniu jest równomiernie dystrybuowane na całym oświetlanym polu tworząc jednorodny obszar roboczy zapobiegając zakłóceniom widoczności mogącym wystąpić przy nieregularnym oświetleniu wywołanym przez doświetlanie centrum pola.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania pkt. 20 załącznika 2.5.

Pytanie 28

Punkt 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której zakres regulacji średnicy pola operacyjnego wynosi 16 -25cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania pkt. 21 załącznika 2.5.

Pytanie 29

Punkt 26

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną bez wbudowanego wskaźnika laserowego umożliwiającego pozycjonowanie lampy względem pola operacyjnego? Oferowana lampa posiada mocno skupioną wiązkę światła, bez trudu umożliwiającą pozycjonowanie lampy względem pola operacyjnego. Wymagany parametr nie jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania lampy i nakierowania wiązki światła, a jedynie niweluje możliwość przedstawienia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści lampę bez wymaganej funkcjonalności opisanej w pkt. 29 załącznika 2.5.

Pytanie 30

Punkt 27

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której oświetlenie endoskopowe włączane jest z panelu sterowania lampy i wynosi 10% natężenia maksymalnego lampy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie techniczne, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 31

Wniosek dotyczący zmiany sposobu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Szanowni Państwo zwracam się z prośbą o zmianę SIWZ oraz PPU w taki sposób aby dopuścić możliwość potrącania zabezpieczenia należytego wykonania umowy z faktur wystawianych przez wykonawcę w trakcie realizacji, co jest częstą praktyką w kontraktach realizowanych dla prywatnych Inwestorów i sprawdza się w praktyce dając korzyści dwóm stronom umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość potrącania zabezpieczenia należytego wykonania umowy z faktur wystawianych przez wykonawcę w trakcie realizacji i odpowiednio zmienia zapis w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik Nr 10 do SWZ), § 11 ust 1.

Pytanie 32.

W trakcie dzisiejszej wizji lokalnej, dotyczącej przebudowy budynku F otrzymałam informację o możliwości wglądu w archiwalną dokumentację budowlaną budynku będącego przedmiotem postępowania ZP.087.2021. Uprzejmie proszę o informację o możliwym terminie w jakim będzie można zapoznać się ze wspomnianą dokumentacją.

Pytanie 33.

Pytanie do przetargu - dot. terminu wizji Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia w dniu dzisiejszym o godz. 10:00 odbyła się wizja lokalna przebudowywanego obiektu. Niestety nie zdążyliśmy wziąć udziału w wizji lokalnej we wskazanym w SWZ terminie. Z uwagi na fakt, iż złożenie oferty bez uprzedniego dokładnego obejrzenia miejsca realizacji nie jest możliwe, zwracam się z pytaniem: czy możliwa będzie wizja lokalna w dodatkowym terminie, a jeśli tak to kiedy?

Odpowiedź na pytania 32 i 33

Zamawiający organizuje dodatkową wizję lokalną z Wykonawcami w dniach **4 i 5 listopada 2021r. od godz. 10:00 do godz. 14:00**, która rozpocznie się spotkaniem wszystkich zainteresowanych w holu głównym Narodowego Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie **o godz. 10:00**. Celem wizji lokalnej jest zapoznanie Wykonawców z miejscem podlegającym przebudowie, jednocześnie Zamawiający udostępnia starą szczerbą dokumentację istniejącego obiektu dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców. Zamawiający zaleca Wykonawcom odbycie wizji zorganizowanej przez Zamawiającego. Szczegółowy godzinowy termin oglądania dokumentacji należy uzgodnić z Działem Technicznym NIKard tel. 694 413 729 lub tel. 725 993 886 lub tel. 22 34 34 142.

2. Jednocześnie dokonuje się zmiany w dokumentach zamówienia w następujący sposób:

W PFU przed zmianą:	W PFU po zmianie:
1.1.3.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (FAZA PROJEKTOWA) POWINNA ZAWIERAĆ:	1.1.3.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (FAZA PROJEKTOWA) POWINNA ZAWIERAĆ:
5. Wielobranżowy projekt techniczny / wykonawczy w formie papierowej i elektronicznej (projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt instalacji, projekt technologii w tym : sanitarnej, elektrycznej, niskoprądowej teletechnicznej, p.poż, drogowy, zieleni, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami.	5. Wielobranżowy projekt techniczny / wykonawczy w formie papierowej i elektronicznej (projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt instalacji, projekt technologii w tym : sanitarnej, elektrycznej, niskoprądowej teletechnicznej, p.poż, drogowy, zieleni), niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami. <u>Projekty techniczne(wykonawcze) oraz powykonawcze: technologii, konstrukcji, sanitarny, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji muszą być wykonane również w technologii BIM.</u>
2.1.4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEŁĄCZNICZY LOKALNEJ PLXX	2.1.4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEŁĄCZNICZY LOKALNEJ PLXX
4 przełączniki sieciowe dostępne z redundantnym zasilaniem: Brocade ICX 7250PoE	4 przełączniki sieciowe dostępne z redundantnym zasilaniem: Brocade ICX 7250-48p PoE


AccesPoint – min. 18 punktów AP Aruba APIN0313	AccesPoint – min. 18 punktów HPE Aruba AP-515
2.1.4.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSYSTEMU POZIOMEGO SIECI STRUKTURALNEJ	2.1.4.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSYSTEMU POZIOMEGO SIECI STRUKTURALNEJ
Wykonawstwo zakłada minimum 115 zestawów oraz min 18 gniazd nadsufitowych RJ-45 do podłączenia Wi-Fi.	Wykonawstwo zakłada minimum 130 zestawów oraz min 18 gniazd nadsufitowych RJ-45 do podłączenia Wi-Fi.
W umowie przed zmianą:	W umowie po zmianie:
§ 19. Zmiany umowy	§ 19. Zmiany umowy
9) w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy w związku ze zmianą zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, iż łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;	9)w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy w związku ze zmianą zakresu przedmiotu zamówienia <u>lub wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych lub innych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy</u> pod warunkiem, iż łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
Załącznik Nr 10 do SWZ, § 11 ust 1	Załącznik Nr 10 do SWZ, § 11 ust 1
„1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości [...] % (zgodnie z SWZ) wynagrodzenia umownego t.j. [...] brutto zł (słownie brutto: [...] zł)	„1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości [...] % (zgodnie z SWZ) wynagrodzenia umownego t.j. [...] brutto zł (słownie brutto: [...] zł) z tym że: a) w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia; b) pozostała kwota zabezpieczenia będzie tworzona przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane; c) Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na swój rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury; d) wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

3. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, zmienia termin związania ofertą oraz zmienia w tym zakresie SWZ w następujący sposób:

W SWZ przed zmianą:	W SWZ po zmianie:
ROZDZ. 18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-02-12.	ROZDZ. 18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-02-15.
ROZDZ. 20. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2021-11-15 do godz. 09:30.	ROZDZ. 20. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2021-11-18 do godz. 09:30.
ROZDZ. 21. TERMIN OTWARCIA OFERT 21.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-11-15 o godz. 10:00 , za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.	ROZDZ. 21. TERMIN OTWARCIA OFERT 21.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-11-18 o godz. 10:00 , za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
26. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 26.1.Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.	26. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 26.1.Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Jednocześnie odpowiednio podlega zmianie ogłoszenie o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

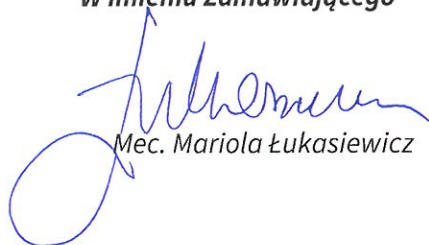

Mec. Mariola Łukasiewicz