

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 22/22PN/2019/6

Bytom dnia: 2019-09-18

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-09-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pakiet 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści igły w op.a' 100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści igły w opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 1ml z dokładną podziałką co 0,02ml lub 0,05ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 1, poz. 4, 11, 12, 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4, 11, 12, 13 z zadania 1 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą do 2,2ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą do 5,5ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą do 11ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą do 22ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe z polem do opisu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 14 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe bez pola do opisu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 200x320cm o średnicy 15cm wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m² z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m², o odporności na przenikanie cieczy 110cm H₂O, z czterema etykietami typu TAG?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe wykonane z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak pod warunkiem paraprzepuszczalności i pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe wykonane z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład laminowany wzmocniony o parametrach:

- Wykonany z pulpy laminowanej
- Wzmocniony 48 nitkami
- Rozmiar: 80 x 210 cm
- Gramatura: 23 gr (papier) + 15 gr (laminat)
- Miękki, wodoodporny, chłonny, wytrzymały
- Kolor: biały
- Jednorazowego użytku
- Niesterylne

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.


Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

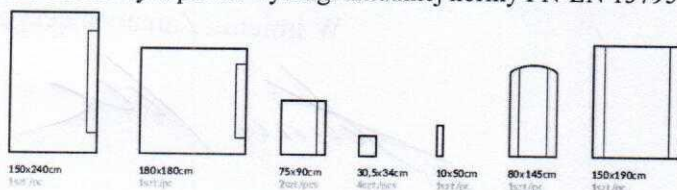

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.


Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

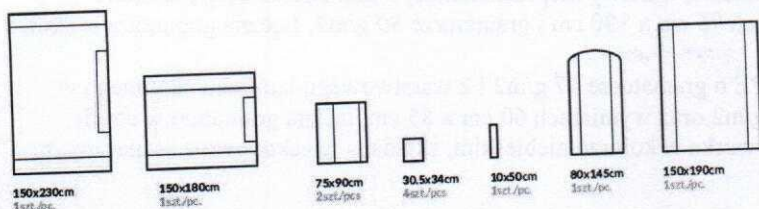

Odpowiedź Zamawiającego:
Nie, zgodnie z SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego