

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595

Białystok, 03.11.2021r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania
przetargowego**

PN-15/21/6/2

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego PN- 15/21/6 na dostawę specjalistycznego sprzętu
medycznego.**

Informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania o przytoczonej poniżej treści: na mocy art. 135 ust. 1-6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udzielamy **wyjaśnień do specyfikacji warunków zamówienia.**

Treść pytań:

1. Dot. pakietu 63

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu, ponieważ jest to asortyment zdecydowanie różniący się od pozycji 3 i 4.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 63 poz. 3 i 4 do osobnego pakietu. Zamawiający dokona modyfikacji w pakiecie 63 wyodrębniając poz. 3 i 4 z pakietu i powstanie pakiet nr 129 – zgodnie z załącznikiem Zmiana nr 2 Formularza Ofertowego.

Pakiet 63:

Nr	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa, nr katalogowy
1	Koc grzewczy dla dzieci na całe ciało o wymiarach 145x76 + 5cm, wykonany z materiału, masa poniżej 180 g, pasujący do dmuchawy typu Warm Touch, nie zawierający lateksu, radioprzezierny	szt.	36		0			0		

2	Koc grzewczy dla dorosłych na całe ciało wym. 183x114 na całe ciało , o wymiarach 183x114 + 5cm, wykonany z materiału, masa poniżej 350 g, pasujący do dmuchawy typu Warm Touch, nie zawierający lateksu, radioprzezierny	szt.	62		0			0		
---	---	------	----	--	---	--	--	---	--	--

Pakiet 129:

Nr	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa, nr katalogowy
1	Woda sterylna do reduktorów tlenowych z adapterem kompatybilnym z reduktorami będącymi własnością Zamawiającego , do nawilżania i nebulizacji ciepłej i zimnej. Możliwość sotosowania u wielu pacjentów do przez okres min 30 dni Skład: jednorazowy pojemnik ze sterylną apirogenną, wolną od endotoksyn wodą, sterylny łącznik nawilżający z zaworem nadciśnieniowym. Butelka ma być wyposażona w system mikrodyfuzorów (znajdujący się w podstawie butelki) umożliwiający przepływ tlenu przez całą objętość wody. Pojemnik 320-350 ml	szt.	100		0			0		

2	Woda sterylna do reduktorów tlenowych z adapterem kompatybilnym z reduktorami będącymi własnością Zamawiającego, do nawilżania i nebulizacji ciepłej i zimnej. Możliwość sotosowania u wielu pacjentów do przez okres min 30 dni Skład: jednorazowy pojemnik ze sterylną apirogenną, wolną od endotoksyn wodą, sterylny łącznik nawilżający z zaworem nadciśnieniowym. Butelka ma być wyposażona w system mikrodyfuzorów (znajdujący się w podstawie butelki) umożliwiający przepływ tlenu przez całą objętość wody. Pojemnik 500-650 ml	szt.	200	0	0				
---	---	------	-----	---	---	--	--	--	--

W związku z wyodrębnieniem z pakietu nr 63 poz. 3 i 4. Nastąpiła zmiana wartości wadium w pakiecie 63 wynosi ona: 139,08 zł., a w pakiecie 129: 60 zł.

2. Pakiet 2 pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści butlę Redona o pojemności 200ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

3. Pakiet 2 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści butelkę o kształcie okrągłym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Pakiet 2 pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści butlę Redona o pojemności 400ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

5. Pakiet 2 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści butlę Redona o pojemności 200ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

6. Pakiet 2 pozycja 8-11

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 70cm bez podziałki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

7. Pakiet 2 pozycja 8-11

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy bez podziałki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

8. Pakiet 19 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren do ran chirurgicznych w całości kontrastujący w RTG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Pakiet 19 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren do ran chirurgicznych bez agrałki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.


10. Pakiet 21 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny dren do ssaka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Pakiet 21 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren o zakończeniach jak na zdjęciu:

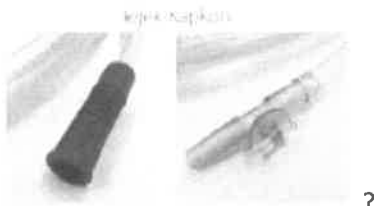

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12. Pakiet 23 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dren do tlenu o długości 210cm +/- 2%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. Pakiet 23 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren do tlenu o długości 426cm +/- 2%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14. Pakiet 25 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren z trokarem 20 Ch o długości 34 +/- 1cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

15. Pakiet 25 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dren z trokarem 16 Ch o długości 21 +/- 1cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

16. Pakiet 27 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści dren typu PENROSE o owalnym kształcie ze specjalnym wewnętrznym ożebrowaniem, zapobiegającym zaginaniu drenu i zamknięciu jego światła



?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

17. Pakiet 27 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren typu PENROSE o długości 30cm w rozmiarach 6,8,10,12 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

18. Pakiet 27 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dren typu PENROSE o długości 30cm w rozmiarze 25mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

19. Pakiet 27 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dren wielokanalikowy o szerokości 45mm i długości 40cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

20. Pakiet 34

Czy Zamawiający dopuści maski przezroczyste o lekkim zabarwieniu zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Pakiet 47 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści równoważną kaniulę dotętnniczą wykonaną z teflonu FEP?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

22. Pakiet 47 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sztywne opakowanie typu blister papier folia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

23. Pakiet 56 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą 20G/34 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

24. Pakiet 56 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą 22G/34 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

25. Pakiet 57 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

26. Pakiet 69 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści marker chirurgiczny sterylny z jedną końcówką – cienką? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

27. Pakiet 69 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści marker chirurgiczny sterylny ze skalą pomiarową na korpusie pisaka 5 cm oraz dodatkowo załączoną dwustronną skalą pomiarową 15 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

28. Pakiet 75 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 43cm x 2,5cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

29. Pakiet 75 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 25cm x 2,0cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

30. Pakiet 75 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 43cm x 2,5cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

31. Pakiet 75 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 25cm x 2,0cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

32. Pakiet 76 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnice o następujących parametrach:

- 6Fr o średnicy 2mm dla rurek od 2,0-4,0, długość robocza 250 mm(+/-5) oraz długość całkowita 310 mm (+/-10),
- 10Fr o średnicy 3,3mm dla rurek od 4,5-6,5, długość robocza 350 mm(+/-5) oraz długość całkowita 390 mm (+/-10),
- 14Fr o średnicy 4,7mm dla rurek od 7,0-10,0, długość robocza 355 mm(+/-5) oraz długość całkowita 390 mm (+/-10) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

33. Pakiet 78 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z balonikiem kontrolnym posiadającym oznaczenie wyłącznie rozmiaru rurki oraz rodzaju?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

34. Pakiet 78 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze skalowaniem co 1 cm od 11 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

35. Pakiet 78 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez oznaczenia poziomu strun głosowych, ale wyposażone w podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

36. Pakiet 80 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone bez oznaczenia poziomu strun głosowych, ale wyposażone w podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

37. Pakiet 80 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z uniwersalnym łącznikiem bez oznaczenia producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

38. Pakiet 80 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z balonikiem bez informacji o rodzaju mankietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

39. Pakiet 82 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze skalowaniem po jednej stronie rurki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

40. Pakiet 82 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem umożliwiającym kontrolę położenia rurki w postaci dwóch pierścieni?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

41. Pakiet 82 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

42. Pakiet 84 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
000	40 mm
00	50 mm
0	60 mm
1	70 mm
2	80 mm
3	90 mm
4	100 mm
5	110 mm
6	120 mm

?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

43. Pakiet 115 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści równoważną prowadnicę do trudnych intubacji 6Fr o długości 535 mm, 10Fr o długości 600 lub 800mm oraz 15Fr o długości 600 lub 800mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

44. Pakiet 123 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści zestawy równoważne innego Producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

45. W wyniku dokonanej modyfikacji w zakresie pakietu 63 wyodrębniając poz. 3 i 4 z pakietu powstanie pakiet nr 129. W związku z powyższym, na podstawie art. 137 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał zmiany specyfikacji warunków zamówienia w zakresie terminu składania ofert i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium:

Termin składania ofert: 23.11.2021r., godz. 08:00 (strona tytułowa SWZ, pkt. XX SWZ)

Termin otwarcia ofert: 23.11.2021r. godz. 09:00 (strona tytułowa SWZ, pkt. XXI SWZ)

Termin wnoszenia wadium: 23.11.2021r., godz. 08:00 (pkt. XIX SWZ)

Termin związania ofertą: 20.02.2022 r., (XVII pkt.1 SWZ)

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Iwona Kisiel

