

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów**

**Opieki Zdrowotnej w Nisku**

ul. Kościuszki 1

37-400 Nisko

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.

Numer referencyjny: Z.II.260.014.Zp.2025

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 7 w poz. 2 gazy hemostatycznej w rozmiarze 7,5cm x10 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 2**

**Pakiet nr 10: Siatka i taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu**

Z uwagi na ujednolicenie przez producenta rozmiaru igieł, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do postępowania dwóch jednorazowych igieł, charakteryzujących się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną. Pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet: o specyfikacji zbliżonej do wymagań Zamawiającego:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zasłonową.

Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,1 cm
- długość: 45 cm

- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 57 g/m<sup>2</sup>
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.

W zestawie znajdują się dwa narzędzia helikalne (prawe + lewe) jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Oferowane przez nas taśmy stosowane są w wielu jednostkach szpitalnych w całej Polsce.

Dopuszczenie naszego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

#### Pytanie nr 4

Dotyczy: Pakiet nr 12

Wnosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na proszek hemostatyczny, pakowany w opakowania fiolka z proszkiem 3g z aplikatorem, opakowanie sterylne - podwójne folia i folia-papier, spełniającego pozostałe wymagania SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**


#### Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10?

Taśmę podcewkową do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet o parametrach:

- materiał niewchłaniałna taśma 100% polipropylenowa, monofilamentowa,
- szerokość 1,1 cm (+/-1 mm),
- grubość 0,34 mm ,
- gramatura 45g/m<sup>2</sup> ,
- laserowo zgrzewane brzegi taśmy,
- taśma w dwuczęściowej polietylenowej osłonce
- zakończona pętelkami

Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte, out-in oraz in-out.

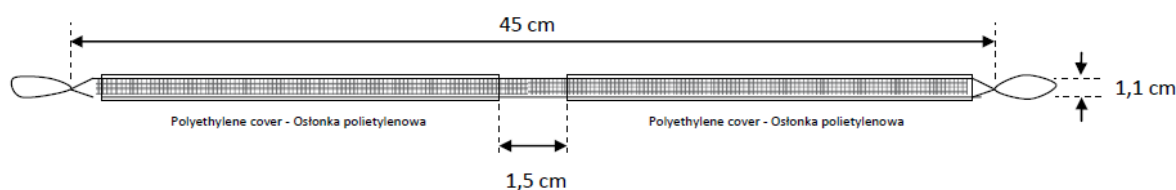

Do implantacji taśm służą narzędzia wielorazowego użytku. Użycie narzędzi wielorazowych oszczędza środowisko poprzez zmniejszenie produkcji odpadów.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 6**

Pakiet 15 poz. 1-3: Czy Zamawiający dopuści siatki w opakowaniu A'1 zamiast A'3 z odpowiednim przeliczeniem ilości? Przyczyną nowych opakowań są zmiany logistyczne, które nie wpłynęły na parametry i produkt pozostaje taki sam.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 7**

Dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 1, 2 i 6 Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g/m<sup>2</sup>. Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękką, łatwodopasowującą się strukturą splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm<sup>2</sup>, średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki.

Rozmiar : pozycja 1 - 10 x 15 cm

Pozycja 2 - 15 x 15 cm

Pozycja 6 - 30,5 x 30,5 cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 8**

Dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 3 i 4 Siatka samomocująca polipropylenowa monofilamentowa nasączona wchłaniącym klejem w czasie 7-10 dni. Klej: PVP – polyvinylpyrrolidone+polyethylene glycol. Klej nie jest materiałem biologicznym (nie pochodzi od ludzi, ani zwierząt) Siatka atraumatyczna monofilamentowa, polipropylenowa o wadze 40.3 g przed absorpcją. Rozmiar porów 6,29 mm<sup>2</sup>. Grubość siatki przed absorpcją 0,35mm. Siatka z możliwością docinania.

Rozmiar : pozycja 3 - 10 x 15 cm uniwersalna


Pozycja 4 - 12 x 15 cm uniwersalna

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 9**

Dotyczy pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5, Narzędzie, dedykowany do mocowania siatek. Ładunki są wchłanialne, zbudowane z PLA (poliaktyd) na bazie kwasu mlekowego. Ładunek wielkości 6.7 mm, część penetrująca 5.9mm - 6mm. Ładunek z gładką głową, wydrążonym rdzeniem i atraumatycznym nagwintowaniem. Średnica głowicy 4,2 mm. Długość trzonu 36cm. Ładunki całkowicie wchłaniają się po 12 -18 miesiącach. Zawiera 15 zszywek. Urządzenia mają wskaźnik zużycia ładunków, są jednorazowe i sterylne. Zestawy pakowane po 5szt

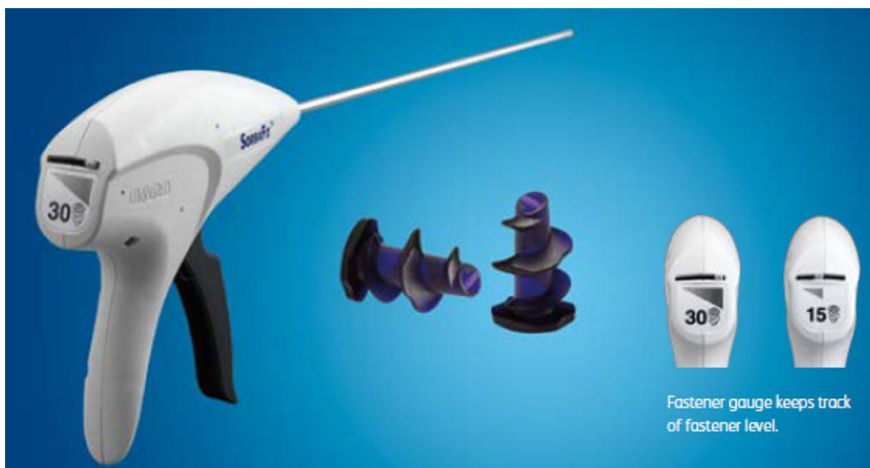

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

### Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści ŚRODEK HEMOSTATYCZNY W POSTACI PROSZKU 3G , POCHODZENIA ROŚLINNEGO DO UŻYCIA JAKO WCHŁANIALNY ŚRODEK HEMOSTATYCZNY, POMAGAJĄCY W TAMOWANIU KRWAWIEŃ PODCZAS ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH. NIE ZAWIERAJĄCY SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO ANI LUDZKIEGO. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W LAPAROSKOPII WRAZ Z APLIKATOREM 14cm lub 38 cm. CAŁKOWITA WCHŁANIALNOŚĆ W CIĄGU MAX. 48 GODZIN. GOTOWY DO UŻYCIA PO WYJĘCIU Z OPAKOWANIA BEZ KONIECZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO PRZYGOTOWYWANIA. NIEWYMAGAJĄCY PRZECHOWYWANIA W SPECJALNYCH WARUNKACH. Możliwość zastosowania przy autotransfuzjach krwi potwierdzona w instrukcji użytkownika. Proszek pakowany po 5 szt x 3g w opakowaniu zbiorczym

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie nr 11

Dotyczy pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Proszek hemostatyczny o działaniu antybakteryjnym uzyskany z oksydowanej regenerowanej celulozy przeznaczonym do tamowania krwawień tętniczych, żylnych oraz włósniczkowych w zabiegach chirurgicznych oraz innych urazach. szybka hemostaza w mniej niż 90 sekund, W pełni wchłaniany przez organizm w ciągu 4-10 dni Waga 3g

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

### Pytanie nr 12

Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, porowatość średnia: 976 µm; porowatość max.: 2314 µm; grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 µm, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien

skośnych, podwójna nić wzmacniająca), która zwiększa wytrzymałość taśmy na rozciąganie we wszystkich kierunkach, co zapobiega zwijaniu się i deformacji taśmy?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 13**

Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści 1 komplet igieł spiralnych (prawa+lewa) wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, implantacja przezzasłonowa?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 14**

Dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści siatkę dwustronna wewnątrznaczyniowa separująca, miękka, niewchłanialna, 2-warstwowa. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego politetrafluoroetylen (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki, a z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość siatki 0,62 mm, porowatość średnia 667 µm, porowatość maksymalna 1359 µm, gramatura średnia 108 g/m<sup>2</sup>, z oznaczeniem czarnym markerem powierzchni siatki, która powinna być skierowana w stronę jelit, o dwukierunkowej elastyczności, owalna, z możliwością docinania siatki. Dostępne rozmiary : 11-14 cm, 14-18 cm, 20-25 cm, 25-35 cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 15**

#### **Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, wykonany z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, wytrzymałość węzła 75% po 2 tygodniach i 50% po 3 tygodniach od wszczepienia, czas wchłaniania 60-70 dni?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 16**

#### **Pakiet 1, poz. 26**

Czy Zamawiający wykreśli, wydzieli ww. pozycję z Pakietu 1 ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 17**

#### **Pakiet 2, poz. 10**

Czy Zamawiający wykreśli ww. pozycję z Pakietu 2?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 18**

#### **Pakiet 2, poz. 9**

Czy Zamawiający szew z igłą 30 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie nr 19**

#### **Pakiet 3, poz. 1-11**

Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy wchłaniany wykonany z polidioksanonu, zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%, okres wchłaniania 180-210 dni?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 20**

**Pakiet 3, poz. 12-17**

Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy wchłaniany wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu, wytrzymałość węzła na rozciąganie 70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, wchłanianie pomiędzy 90-120 dniem?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 21**

**Pakiet 3, poz. 4, 6**

Czy Zamawiający dopuści igłę 22 mm lub 26 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 22**

**Pakiet 3, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści igłę 37 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 23**

**Pakiet 5, poz. 1-8**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku polietylenu?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 24**

**Pakiet 5, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści igłę 30 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja nr 1 – 4 dopuści szew o parametrach pierwotnie wyspecyfikowanych w SWZ z dodatkowym powleczeniem substancją o szerokim spektrum działania antybakteryjnego – triklosanem?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 10 dopuści podwiązkę endoskopową bez aplikatora, rozmiar nici 0, długość 40 cm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 27**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 13 dopuści nić o długości 70 cm reszta parametrów zgodna z SWZ ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 18 dopuści igłę 1/2 koła okrągło tnącą 45mm reszta parametrów zgodna z SWZ ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 29**

**Pakiet 3, poz. 1-11**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu o następującym opisie:

Szew wchłaniany, monofilamentowy wykonany z glikolidu i ε-kaprolaktonu. Czas podtrzymania tkankowego 30 dni, okres całkowitego wchłaniania 90-120 dni; 60% po 7 dniach; 30% po 14 dniach?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 30**

**Pakiet 3, poz. 12-17**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu o następującym opisie:

Szew wchłaniany, monofilamentowy wykonany z poli-p-dioksanonu. Wytrzymałość węzła na rozciąganie 50% po 45 dniach, wchłanianie pomiędzy 180-240 dni?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 31**

**Pakiet 3, poz. 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici o grubości 1? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 32**

**Pakiet 3, poz. 3, 5**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici z igłą o długości 18mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 33**

**Pakiet 3, poz. 4, 6**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici z igłą o długości 22mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 34**

**Pakiet 3, poz. 8**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici z igłą o długości 27mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 35****Pakiet 3, poz. 8-11, 13**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici o długości 75cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 36****Pakiet 3, poz. 12**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici z igłą o długości 37mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 37****Pakiet 5 poz. 1-8**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu syntetycznego, monofilamentowy, wykonany z polipropylenu, bez efektu kapilarnego, o gładkiej i nieporowatej powierzchni?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 38****Pakiet 5, poz. 9-13**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu plecionego z poliestru, powlekanego silikonem, szew niewchłaniający, syntetyczny?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 39****Pakiet 5, poz. 14-26**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu monofilamentowego, syntetycznego, wykonanego z poliamidu 6, niewchłaniający?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 40****Pakiet 5, poz. 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici o długości 75cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 41****Pakiet 5, poz. 5**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu z igłą o długości 30mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 42****Pakiet 5, poz. 7**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici o grubości 1 i długości 90cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.



**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 43**

**Pakiet 5, poz. 10**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici z igłą ½ koła okrągła 26mm **bez wzmocnienia**? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 44**

**Pakiet 5, poz. 13**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici o grubości 2? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 45**

**Pakiet 5, poz. 20-21**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici z igłą o długości 25mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 46**

**Pakiet 5, poz. 24**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici o długości 150cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 47**

**Pakiet 5, poz. 25**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici o długości 90cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 48**

**Pakiet 5, poz. 26**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici z igłą o długości 35mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 49**

**Dotyczy §3 ust. 5 wzoru umowy**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisu w następujący sposób:  
„W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w §3 ust. 2 niniejszej umowy dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez

Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy.”

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie nr 50**

##### **Dotyczy wzoru umowy**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy: „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.”

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie nr 51**

Dotyczy §5 ust. 1 lit. c wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący sposób:

„20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie nr 52**

Dotyczy §5 ust. 3 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący sposób:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakie mogą obciążyć Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wartości brutto Umowy określonej w §2 ust. 1.”

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.**

**Dyrektor**  
**SPZZOZ w Nisku**  
**Paweł Tofil**  
*/podpisano elektronicznie/*