

Pisz, 02.12.2024r.

Prezes

Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Wykonawca - Przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego:

Bialmed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

Tel.: 87 424 11 73

fax. 87 424 11 85

adres poczty elektronicznej: dzp@bialmed.pl

Zamawiający:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Przybyszewskiego 49, 60-535 Poznań

Tel. 618691187

adres poczty elektronicznej: dzp@usk.poznan.pl

Odwołujący się:

Skamex Spółka Akcyjna

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

Fax 042 677-14-19; 042 672-40-10



Reprezentowany przez

adw. Kamilę Podwapińską

„PSK Podwapińska, Brzezińska Adwokaci” Spółka Partnerska

ul. Samochodowa 2 lok. 21, 02-652 Warszawa

e-mail: podwapinska@pskl.pl

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr DZP/129/2024 Wyroby medyczne jednorazowego użytku - asortyment ogólnego przeznaczenia, sprzęt drobny, anestezjologia

**Zgłoszenie przystąpienia Wykonawcy
do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego**

W związku z wniesieniem przez Skamex Spółka Akcyjna odwołania z dnia 28.11.2024r., którego kopię Przystępujący do postępowania otrzymał w dniu 29.11.2024r., wykonawca - Bialmed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 525 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „pzp”), niniejszym: **zgłasza przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.**

Bialmed Sp. z o.o. posiada interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego na korzyść Zamawiającego, gdyż uwzględnienie odwołania zgodnie z jego treścią powodowałoby odrzucenie oferty Przystępującego i wybór oferty Odwołującego się.

Bialmed Sp. z o.o. wskazuje, że odwołanie złożone przez Skamex Sp. z o.o. jest bezpodstawne i w związku z tym **wnosi o oddalenie przedmiotowego odwołania w całości.**



Odnosząc się do zarzutów odwołania wskazać należy, że wbrew odmiennym twierdzeniom Odwołującego, zaproponowany przez naszą firmę w pakiecie nr 3 poz. 1 produkt spełnia wymogi SWZ oraz funkcję, do jakiej jest przeznaczony, czyli przetaczanie płynów infuzyjnych.

W pierwszej kolejności Przystępujący wskazuje, iż oferowany przez niego przyrząd spełnia wszystkie wymogi zgodnie z dopuszczeniem Zamawiającego zawartym w odpowiedzi na pytanie 224


Pytanie 224: Dotyczy Pakiet 3, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PCV o długości 55mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów, igła biorcza ścięta czteropłaszczyznowo wykonana ze wzmocnionego ABS, z wysokiej skuteczności filtrem w odpowietrzniku, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie folia-papier, sterylne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Należy wskazać na fakt, że tak jak w opisie SWZ, również w pytaniu nie ma określenia, jak te ścięcia mają przebiegać, których płaszczyzn dotyczyć. Należy skupić się na całokształcie igły biorczej, a nie tylko na jej końcówce. Patrząc szerzej na zadane pytanie i udzieloną odpowiedź można jednoznacznie stwierdzić, iż zaoferowany przez naszą firmę przyrząd posiada nie tylko dwie wymagane, a cztery płaszczyzny ścięcia zgodnie z udzielonym pytaniem i dopuszczeniem.



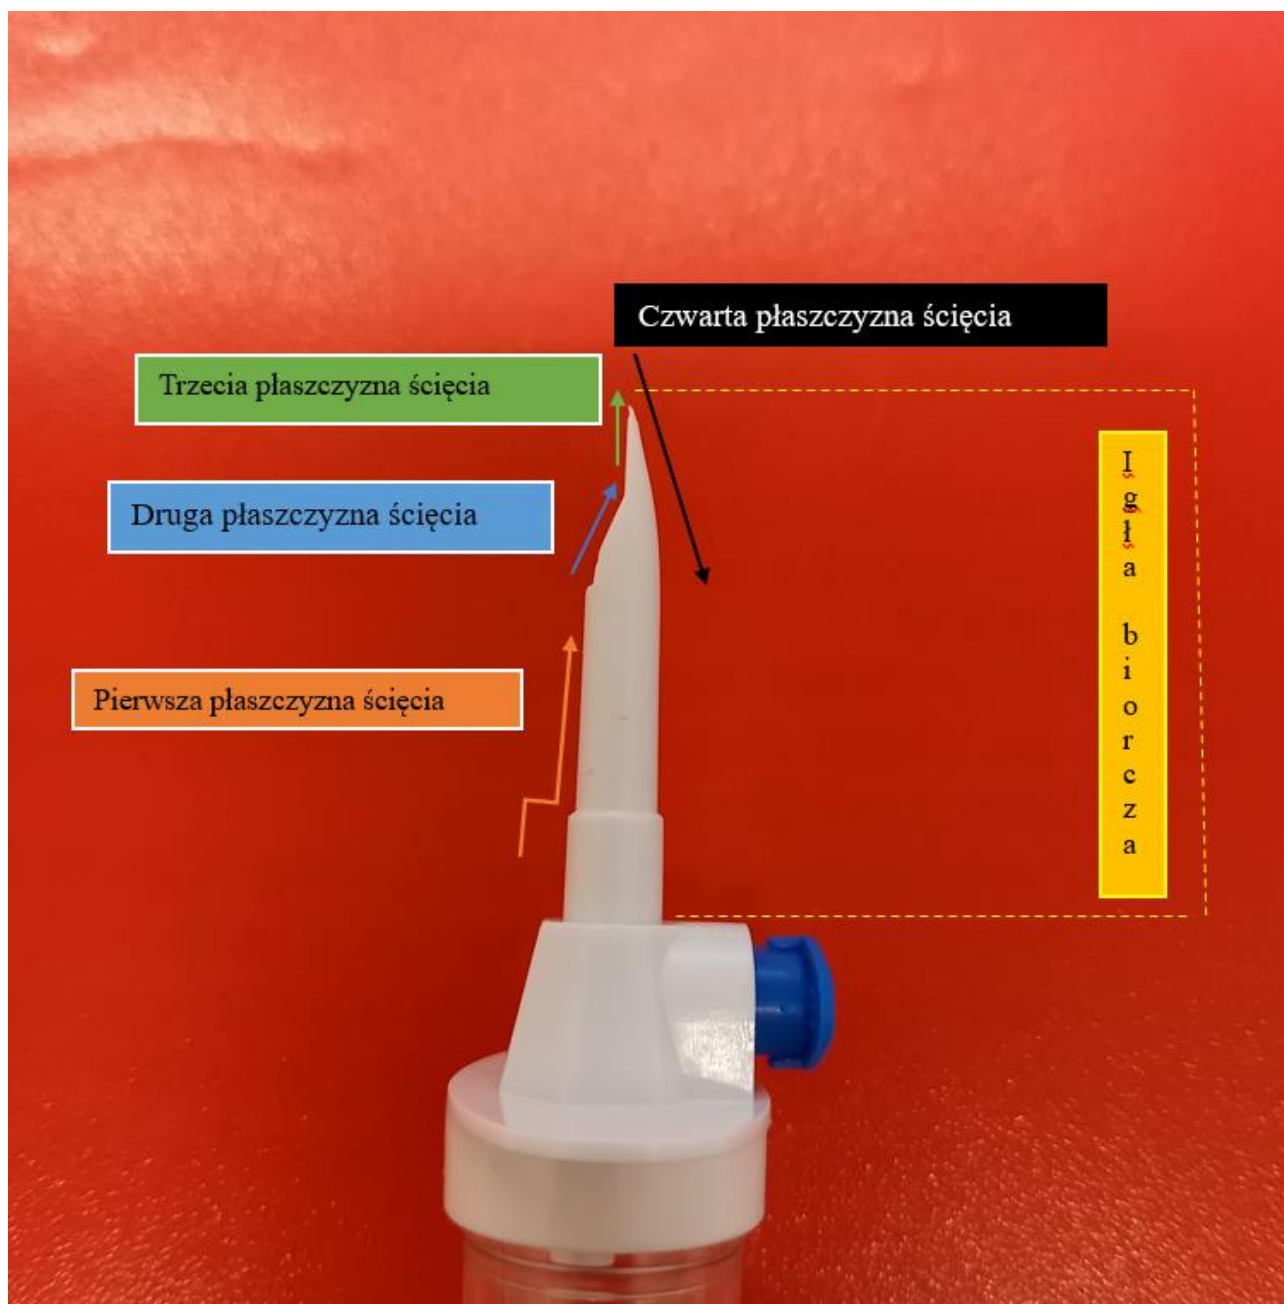


Powyższy rysunek potwierdza, iż igła biorcza, jaką posiada zaoferowany przez Przystępującego wyrób, spełnia wymóg czteropłaszczyznowego ścięcia.



Niezależnie od powyższego podkreślić należy, iż Zamawiający w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia sam postawił wymóg, aby zaoferowane przyrządy miały m.in. igłą biorcą dwukanałową, ściętą dwupłaszczyznowo, zatem próba zdyskredytowania przez Odwołującego zaoferowanego przez naszą firmę produktu jest niezasadna. Należy również wyjaśnić, iż igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo jest tylko potoczną nazwą dla zaoferowanego rodzaju ścięcia, gdyż żadne wytyczne, normy czy też inne przepisy prawne nie regulują tejże nazwy. Również Zamawiający nie określił szczegółowo, jak to ścięcie i płaszczyzny mają wyglądać. Potocznie przyjęto, iż ten rodzaj igły ma dwa główne ścięcia, stąd określona nazwa, aczkolwiek nie ma norm określających jak te ścięcia powinny przebiegać, gdzie występować, stąd też skoncentrowanie uwagi tylko na końcówce igły biorczej.



Zdjęcie igły potocznie nazywanej igłą ściętą dwupłaszczyznowo:

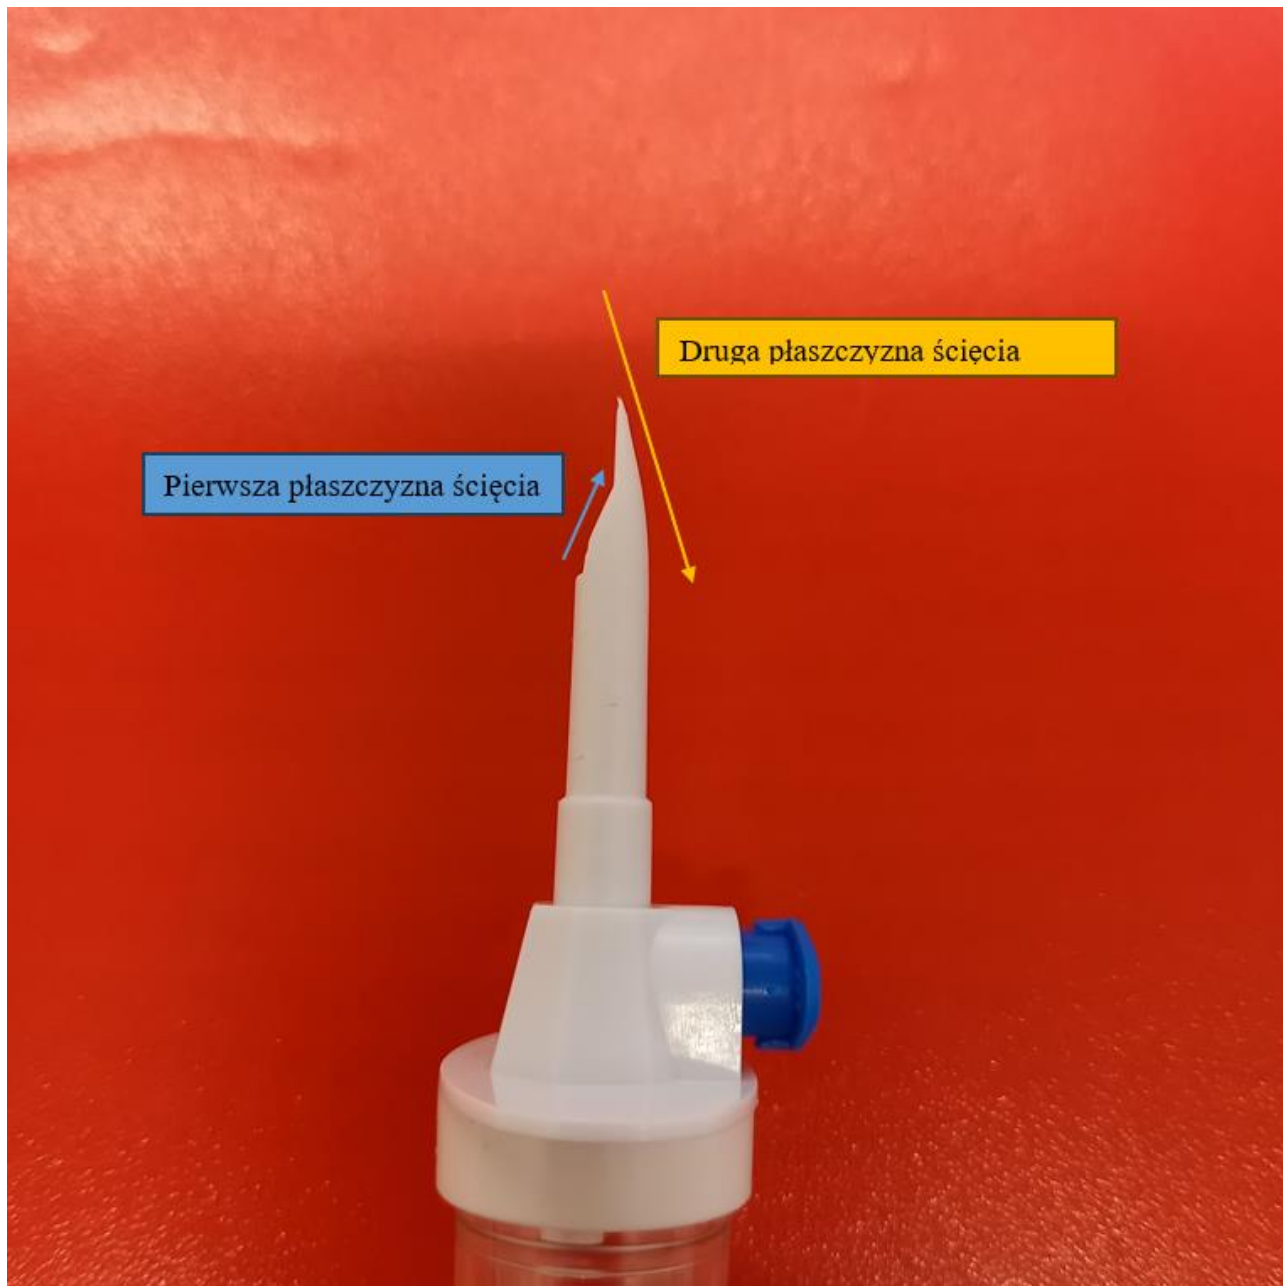

Odwołujący również zaoferował przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, którego igła jest ścięta dwupłaszczyznowo, a jednocześnie domaga się odrzucenia oferty Bialmed sp. z o.o. oferującej przyrząd z taką samą igłą ściętą dwupłaszczyznowo .

Należy również nadmienić, iż przyrząd z igłą biorczą dwu, trzy czy też czteropłaszczyznową w dalszym ciągu jest przyrządem służącym do pobierania płynów infuzyjnych

Reasumując, zaoferowane przez naszą firmę przyrządy spełniają wymogi postawione w SWZ.

Załączniki:

- 1) *pełnomocnictwo reprezentowania Bialmed sp. z o.o.*
- 2) *informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS dot. Bialmed sp. z o.o.*
- 3) *dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia Zamawiającemu*
- 4) *dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia wykonawcy wnoszącemu odwołanie.*

