



BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
49-301 BRZEG, ul. MOSSORA 1
tel. 77 444 65 75, sekretariat 77 444 65 36,
e-mail: zamowienia.publiczne@bcmbrzeg.pl
REGON: 000 313 437 NIP: 747 15 71 941

PN/4/2024

Brzeg, 6.09.2024 r.

**Do wszystkich
Wykonawców, którzy pobrali
Specyfikację Warunków Zamówienia**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „[Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu](#)” – PN/4/2024.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Zamawiający - Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły w dniach **18.08. 2024 r. -30.08.2024 r.** do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych części, do których Wykonawca przystępuje?

Odpowiedź:

Wypełniając formularz ofertowy – Zał. Nr 1 do SWZ, proszę o wypełnienie tylko tych części/pakietów, co do których Wykonawca składa ofertę. Pozostałe części proszę zostawić niewypełnione.

Pytanie nr 3

Dotyczy X.2 SWZ:

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy?

Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „*lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem:*”

Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „*karty charakterystyk substancji niebezpiecznych dla odczynników lub oświadczenie, że Wykonawca dostarczy karty charakterystyk substancji niebezpiecznych dla odczynników na każde żądanie Zamawiającego.*”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, karty charakterystyk odczynników, wymagane do złożenia w ramach Pakietu nr 3 stanowią przedmiotowe środki dowodowe i winny być złożone wraz z ofertą.

Pytanie nr 4

Dotyczy - Załącznika nr 2.3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy, tabela parametry techniczne i użytkowe bezwzględnie wymagane dla automatycznego analizatora hematologicznego z rozdziałem na 5 populacji, pkt 22:

Uprzejmie prosimy o ujednolicenie zapisu z Załącznikiem nr 10.2 do SWZ – Wzór umowy dzierżawy §2 pkt 2 lit. c) i zastąpienie wyrażenia „Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin w dni robocze.” zwrotem „Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 48 godzin w dni robocze.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokona w powyższym zakresie ujednolicenia zapisów. Patrz: zmiana nr 1.

Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznika nr 2.3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy, tabela parametry techniczne i użytkowe bezwzględnie wymagane dla automatycznego analizatora hematologicznego z rozdziałem na 5 populacji, pkt 23:

Uprzejmie prosimy o ujednolicenie zapisu z Załącznikiem nr 10.2 do SWZ – Wzór umowy dzierżawy §2 pkt 2 lit. c) i dodanie po zwrocie „na czas naprawy powyżej 48 godzin” wyrażenia „w dni robocze”.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona w powyższym zakresie ujednolicenia zapisów. Patrz: zmiana nr 2.

Pytanie nr 6

Dotyczy Załącznika nr 10.1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, §1 ust. 8:

Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych (informowanie o potencjalnych zagrożeniach) i w sprawach dotyczących działań logistycznych, na wskazany w §1 ust. 8 adres e-mail w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy?

Odpowiedź:

W §1 ust. 8 Zamawiający poda kontakt telefoniczny i adres e-mail do osoby odpowiedzialnej za kontrolę i nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego. Na wskazany adres e-mail będzie można wysyłać informacje dotyczące sprawach merytorycznych związanych z realizacją umowy.

Pytanie nr 7

Dotyczy Załącznika nr 10.1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, §7 ust. 10 w związku z §8 ust. 3 pkt 2):

Prosimy o usunięcie zapisu lub o jego modyfikację poprzez dodanie zdania:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi korelacji pomiędzy brzmieniem §7 ust. 10 umowy w związku z §8 ust. 3 pkt 2) umowy a art. 433 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Postanowienie to nie stanowi wykorzystania przewagi kontraktowej, a jest wyrazem konieczności zapewnienia przez szpital ciągłości świadczeń zdrowotnych, co do których szpital jest zobowiązany ustawowo. Ponadto kondycja finansowa szpitala jest na dobrym poziomie. Szpital nie zalega z płatnościami, dlatego zapis proponowany przez Wykonawcę nie znajduje uzasadnienia.

Pytanie nr 8

Dotyczy Załącznika nr 10.3 do SWZ – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, §3 ust. 1 lit. i):

Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie zdania:

„wyłącznie w zakresie danych dotyczących realizacji umowy Głównej, których Powierzający jest Administratorem”.


Odpowiedź:

Zamawiający dokona w powyższym zakresie doprecyzowania zapisu §3 ust. 1 lit. i) Zał. Nr 10.3 do SWZ. Patrz: zmiana nr 3.

Pytanie nr 9

Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu ?

Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczytnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).

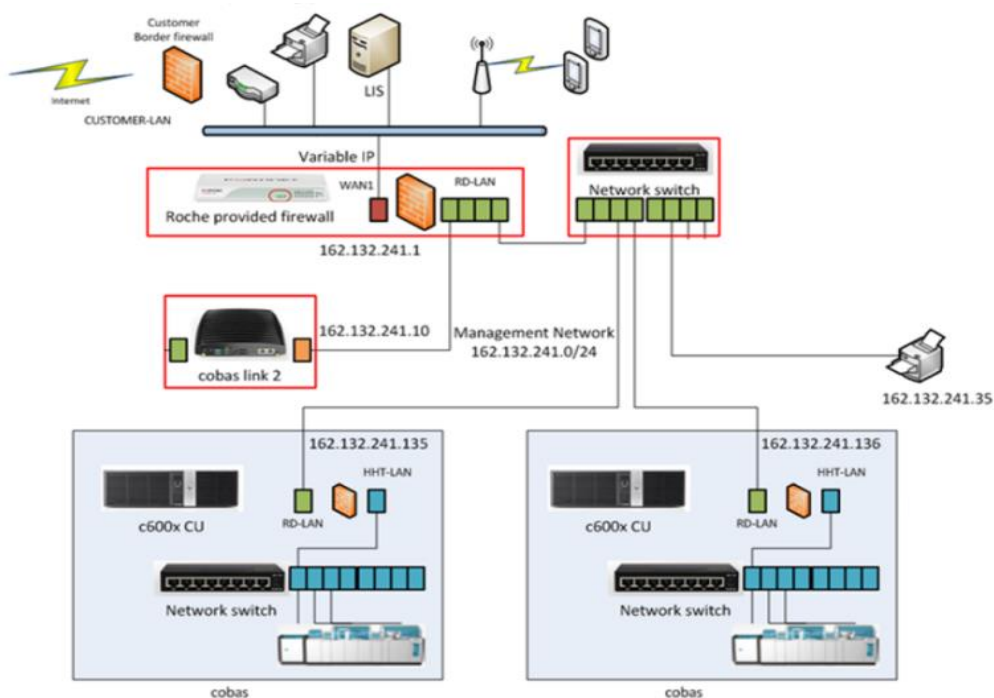

URL	IP	Port	Typ	Description
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navify.com	193.228.103.0/24	433 (514/541)	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
rln-cm-*.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 80	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zapewnia dostęp do internetu (w celach aktualizacyjnych i serwisowych) na wydzielonych portach określonych przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga jednak, aby urządzenie mogło pracować bez dostępu do internetu przez min. 48 h. Zapewniający wymaga, aby komunikacja z LIS i HIS odbywała się na poziomie sieci lokalnej szpitala.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na długie terminy realizacji podłączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie może zgodzić się na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci do 8 tygodni od daty podpisania umowy, z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości wykonywanych badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Zamawiający powziął informację od dostawcy systemu LIS, że możliwym terminem na podłączenie analizatorów będzie 14 dni. W związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego do 14 dni od daty podpisania umowy. Patrz zmiana nr 9.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii

aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W pkt 4 c) formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SWZ) Wykonawca może doprecyzować sposób zgłaszania problemów w przypadku reklamacji i może wskazać aplikację Wykonawcy do tego służącą (tj. stronę internetową).

Pytanie nr 12

Dot. pktu X.1 SWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych deklaracji zgodności załączyć oświadczenie do oferty o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego? Jednocześnie Wykonawca poda w ofercie adres strony internetowej, na której znajdują się ww dokumenty, z której Zamawiający może stale korzystać. Do oferty dołączymy deklarację zgodności oferowanego analizatora

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Deklaracje zgodności, wymagane do złożenia stanowią przedmiotowe środki dowodowe i winny być złożone wraz z ofertą. Ponadto, zgodnie z wymaganiami SWZ, Wykonawca w celu usprawnienia procesu oceny ofert, musi dokonać odpowiedniego oznaczenia, której pozycji asortymentowej i którego pakietu dotyczy składana deklaracja zgodności. Zamawiający nie może domyślać się w tej kwestii odczytując dane z podanej strony internetowej Wykonawcy.

Zgodnie z Działem X SWZ - pkt. 1 tabeli, Zamawiający wymaga złożenia deklaracji zgodności tylko w odniesieniu do odczynników. Powyższe nie dotyczy dzierżawy analizatorów.

Pytanie nr 13

Dot. Pakietu nr 2, pkt. 3 PARAMETRY (WYMAGANIA) TECHNICZNE I UŻYTKOWE DLA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO, Załącznik Nr 2.2 do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który produkowany jest przez innego producenta wyłącznie dla firmy Oferenta produkującej odczynniki i stanowi jednolity system analityczny z oferowanymi odczynnikami? Oferent gwarantuje pełną dokumentację walidacyjną oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z oferowanym analizatorem, wraz z deklaracjami CE. W Deklaracji CE dla analizatora umieszczone są obie firmy: producenta aparatu i producenta odczynników.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14

Dot. Pakietu nr 2, pkt. 9 PARAMETRY (WYMAGANIA) TECHNICZNE I UŻYTKOWE DLA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO, Załącznik Nr 2.2 do SWZ:

Prosimy o doprecyzowanie czy przez wymóg odczynniki "płynne, gotowe do użycia", Zamawiający wymaga takich reagentów które przed wstawieniem na pokład analizatora nie wymagają żadnych dodatkowych czynności przygotowawczych: rozpuszczania, mieszania czy łączenia składników?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga reagentów, które nie wymagają żadnych dodatkowych czynności przygotowawczych.

Pytanie nr 15

Dot. Pakietu nr 2, pkt. 12 PARAMETRY (WYMAGANIA) TECHNICZNE I UŻYTKOWE DLA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO, Załącznik Nr 2.2 do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, który nie posiada wydzielonego, chłodzonego obszaru na kalibratory i kontrole? Materiały te można wstawić w każdej pozycji statywu i w każdym momencie oznaczyć dlatego nie wymagają ciągłego przechowywania na pokładzie analizatora.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16

Dot. Pakietu nr 2, pkt. 14 PARAMETRY (WYMAGANIA) TECHNICZNE I UŻYTKOWE DLA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO, Załącznik Nr 2.2 do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby uzupełnianie odczynników odbywało się bez przerywania procesu analizy, w trybie "wstrzymanie pobierania statywów" trwającym nie dłużej niż 5 min.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17

Dot. Pakietu nr 2, pkt. 28 PARAMETRY (WYMAGANIA) TECHNICZNE I UŻYTKOWE DLA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO, Zał. Nr 2.2 do SWZ:

W związku z wymogiem pkt. 9 parametrów wymaganych, prosimy o doprecyzowanie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga aby identyfikacja odczynników odbywała się za pomocą kodów RFID, natomiast probówek za pomocą czytnika barkodów?

Odpowiedź:

Oczywiście, że identyfikacja odczynników odbywać się będzie za pomocą kodów RFID, jak to zresztą wynika z pkt. 9 , natomiast identyfikacja probówek za pomocą czytnika barkodów. Zamawiający w doprecyzuje wymaganie w pkt. 28 w następujący sposób:

Jest:

Możliwość czytania barkodów z probówek i odczynników

Winno być:

Możliwość czytania barkodów z probówek i odczynników z kodów RFID.

Patrz zmiana nr 10.

PYTANIA DO UMOWY:

Pytanie nr 18

Zał. nr 10.1 projektowane postanowienia umowy

Par. 2 ust. 5-7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Patrz zmiana nr 11.

Pytanie nr 19

Zał. nr 10.1 projektowane postanowienia umowy

Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych wynosiła 10 % wartości umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu umowy w zakresie obniżenia łącznej wysokości kar umownych do 10%.

Pytanie nr 20

Zał. nr 10.1 projektowane postanowienia umowy

Par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację - zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wskazać należy, iż nakaz określony w art. 433 pkt 1 Pzp odnosi się do konstrukcji tych postanowień umownych, które dotyczą wykonania przedmiotu umowy. Przedmiotem tej umowy jest dostawa odczynników i umowa nie przewiduje kar za opóźnienie. Par. 7 ust. 5 odnosi się natomiast do czynności następczych, związanych z zapłatą już uprzednio naliczonej kary umownej. Płatności i kwestie opóźnień i zwłoki są uregulowane w art. 481 k.c. Zgodnie z par. 1 „Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.” PZP nie wyłącza powszechnie obowiązującej regulacji w tym zakresie. W przypadku tego postanowienia wskazane jest uprawnienie dokonania potrącenia należności podmiotu leczniczego.

Pytanie nr 21

Zał. nr 10.1 projektowane postanowienia umowy

Par. 7 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź:

Z uwagi na to, iż Zamawiającym jest podmiotem leczniczym brak posiadania odpowiednich odczynników uniemożliwia diagnostykę pacjentów, którzy przebywają na oddziale. Z tym wiąże się ponoszenie wymiernych kosztów ich bytności w szpitalu oraz zajmowania łóżka pacjentom, którzy

mogą być bardziej potrzebującymi. Kara ma mobilizować wykonawcę do jak najszybszego dostarczenia zamówienia i choć częściowo kompensować straty.

Pytanie nr 22

Zał. nr 10.1 projektowane postanowienia umowy

Par. 7 ust. 10 Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Dlatego prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie:

„nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi korelacji pomiędzy brzmieniem §7 ust. 10 umowy a art. 433 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Postanowienie to nie stanowi wykorzystania przewagi kontraktowej, a jest wyrazem konieczności zapewnienia przez szpital ciągłości świadczeń zdrowotnych, co do których szpital jest zobowiązany ustawowo. Ponadto kondycja finansowa szpitala jest na dobrym poziomie. Szpital nie zalega z płatnościami, dlatego zapis proponowany przez Wykonawcę nie znajduje uzasadnienia.

Pytanie nr 23

Zał. nr 10.1 projektowane postanowienia umowy

Par. 7 ust. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu "lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu umowy.

Pytanie nr 24

Zał. nr 10.1 projektowane postanowienia umowy

Par. 8 ust. 2 pkt 1) i 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie: "Umowę można rozwiązać po wyczerpaniu 70% wartości umowy, zgodnie z par. 2 ust. 3."?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Zał. nr 10.1 projektowane postanowienia umowy

Par. 8 ust. 2 pkt 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia?

Ewentualnie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie przesłanek uprawniających do odstąpienia?

Odstąpienie od umowy bez wskazania jakiejkolwiek przyczyny powoduje narażenie Wykonawcy na straty, które Wykonawca może w kalkulować w cenę oferty co ostatecznie jest zjawiskiem niekorzystnym dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 8 ust. 2 pkt 3) projektowanych postanowień umowy. Zamawiający doprecyzował szczegółowo przesłanki odstąpienia od umowy, wskazując na nie w § 8 ust. 3 Zał. Nr 10.1 do SWZ. W § 8 ust. 2 mowa jest o przypadkach, w których umowa ulega rozwiązaniu, a jedną z takich sytuacji określa ust. 2 pkt 3).

Pytanie nr 26

Zał. nr 10.1 projektowane postanowienia umowy

Par. 9 ust. 2 pkt 4) i 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Patrz zmiana nr 12.

Pytanie nr 27

Zał. nr 10.1 projektowane postanowienia umowy

Par. 9 ust. 2 pkt 9) lit. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia, tak aby Waloryzacja mogła następować co 3 miesiące, przy zachowaniu, iż pierwsza Waloryzacja może być dokonana po 6 miesiącach od zawarcia Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji wskazanego zapisu umowy. Zapis ten został określony tak, że umożliwia Wykonawcy co najmniej raz do roku dokonać waloryzacji

wynagrodzenia.

Pytanie nr 28

Załącznik nr 10.1 projektowane postanowienia umowy

Par. 11 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 29

Załącznik nr 10.2 projektowane postanowienia umowy dzierżawy

Par. 4 ust. 2 pkt 1) i 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie: "Umowę można rozwiązać po wyczerpaniu 70% wartości Umowy nr na dostawę odczynników, zgodnie z par. 2 ust. 3 wskazanej Umowy"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Załącznik nr 10.2 projektowane postanowienia umowy dzierżawy

Par. 4 ust. 2 pkt 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia? Ewentualnie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie przesłanek uprawniających do odstąpienia?

Odstąpienie od umowy bez wskazania jakiejkolwiek przyczyny powoduje narażenie Wykonawcy na straty, które Wykonawca może w kalkulować w cenę oferty co ostatecznie jest zjawiskiem niekorzystnym dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 4 ust. 2 pkt 3) projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 10.2 do SWZ). Zamawiający doprecyzował szczegółowo przesłanki odstąpienia od umowy, wskazując na nie w § 4 ust. 3 i ust. 4 Załącznik nr 10.2 do SWZ.

W § 4 ust. 2 mowa jest o przypadkach, w których umowa ulega rozwiązaniu, a jedną z takich sytuacji określa ust. 2 pkt 3).

Pytanie nr 31

Załącznik nr 10.2 projektowane postanowienia umowy dzierżawy

Par. 7 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna była liczona od „niezrealizowanej wartości umowy brutto”? Specyfika realizacji przedmiotu Umowy, polegającego na świadczeniu ciągłym, przez okres ustalony w kontrakcie, czyni nieuzasadnionym naliczanie kar, w stosunku do wartości globalnej umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma uwag do umowy w części wykonanej do daty wypowiedzenia. W przeciwnym razie kara umowna powinna zostać uznana za wygórowaną zgodnie z art. 484 k.c.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Patrz zmiana nr 13.

Pytanie nr 32

Załącznik nr 10.2 projektowane postanowienia umowy dzierżawy

Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych wynosiła 10 % wartości umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu umowy w zakresie obniżenia łącznej wysokości kar umownych do 10%.

Pytanie nr 33

Załącznik nr 10.2 projektowane postanowienia umowy dzierżawy

Par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację - zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wskazać należy, iż nakaz określony w art. 433 pkt 1 Pzp odnosi się do konstrukcji tych postanowień umownych, które dotyczą wykonania przedmiotu umowy. Przedmiotem tej umowy jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów i umowa nie przewiduje kar za opóźnienie. Par. 7 ust. 5 odnosi się natomiast do czynności następczych, związanych z zapłatą już uprzednio naliczonej kary umownej. Płatności i kwestie opóźnień i zwłoki są uregulowane w art. 481 k.c. Zgodnie z par. 1 „Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej

szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi." PZP nie wyłącza powszechnie obowiązującej regulacji w tym zakresie. W przypadku tego postanowienia wskazane jest uprawnienie dokonania potrącenia należności podmiotu leczniczego.

Pytanie nr 34

Załącznik nr 10.2 projektowane postanowienia umowy dzierżawy

Par. 7 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu "lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Załącznik nr 10.2 projektowane postanowienia umowy dzierżawy

Par. 11

W projekcie umowy, nie zawarto postanowień umownych, dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W związku z tym, że umowa, która zostanie zawarta w wyniku przetargu, ma być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, postanowienia takie są wymagane przez art. 439 Prawa zamówień publicznych.

Czy wobec powyższego postanowienia te zostaną wprowadzone do projektu umowy?

Poniżej dołączamy proponowane przez nas brzmienie postanowień zgodnych z art. 439 PZP.

1. Strony zobowiązują się dokonywać zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostawy określonych w Umowie produktów (w szczególności odczynników, materiałów zużywalnych, części zamiennych) określonego w §6 Umowy oraz w załącznikach do niej („Waloryzacja”), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia („Zmiana cen”).
2. Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do kwartału poprzedniego, publikowany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („GUS”) na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych („Wskaźnik”).
3. Przyjmuje się, że Zmiana cen nastąpiła, jeżeli Wskaźnik osiągnął wartość większą lub równą 3%.
4. Przyjmuje się, że Zmiana cen wpływa na koszt wykonania Zamówienia odpowiednio do wysokości Wskaźnika, przy czym Waloryzacja następować będzie w wysokości wynoszącej połowę Wskaźnika.
5. Waloryzacja następować będzie co 3 miesiące, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia Umowy.
6. W dniu, w którym zgodnie z ust. 5 następuje Waloryzacja, zmienia się wynagrodzenie w zakresie wskazanym w ust. 1, biorąc pod uwagę wartość Wskaźnika ostatnio opublikowaną przez Prezesa GUS, o ile wartość ta będzie większa lub równa wartości wskazanej w ust. 3. Odpowiednio zmienione zostają ceny poszczególnych pozycji załącznika asortymentowo-cenowego.
7. W razie potrzeby, przy wyliczaniu Waloryzacji, ceny zaokrągla się w dół do pełnych groszy.
8. W przypadku drugiej i kolejnych Waloryzacji, cenami wyjściowymi, które będą waloryzowane, będą ceny powstałe w wyniku poprzedniej Waloryzacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian jakie od czasu poprzedniej Waloryzacji zostały dokonane w drodze aneksów do Umowy.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy.
10. Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy. Po Waloryzacji, w razie potrzeby, Wykonawca przekaze Zamawiającemu załącznik asortymentowo-cenowy zmieniony zgodnie z niniejszym paragrafem.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona w powyższym zakresie zmiany treści SWZ wprowadzając do umowy dzierżawy (Załącznik Nr 10.2 do SWZ) zapisy odnoszące się do waloryzacji wynagrodzenia. Patrz zmiana nr 14.

Pytanie nr 36

Załącznik nr 10.2 projektowane postanowienia umowy dzierżawy

Par. 11 ust. 2 lit. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Patrz zmiana nr 16.

Pytanie nr 37

Załącznik nr 10.2 projektowane postanowienia umowy dzierżawy

Par. 12 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 38

Załącznik nr 10.3 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Par. 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia w sposób zezwalający Wykonawcy na podpowierzenie przetwarzania spółkom powiązanym i podwykonawcom Wykonawcy w zakresie przetwarzania, znajdującym się również poza EOG? Przetwarzanie danych polegać będzie wyłącznie na potencjalnym dostępie zdalnym do analizatorów - serwisant spoza EOG uzyska realny dostęp do danych tylko jeśli otrzyma otrzymana prośbę o wsparcie, a jednocześnie dane osobowe będą umieszczone w analizatorze. Lista podmiotów zostanie przedłożona Zamawiającemu do akceptacji. Globalne koncerny podczas świadczenia dostaw lub usług wykorzystują spółki ze swoich grup kapitałowych, co pozwala na korzystanie z unikalnej wiedzy o danym produkcie lub dostępu do tego produktu. Wykonawca zapewnia zgodność z wymaganiami i obowiązuje podwykonawców do przestrzegania takich samych warunków, którym sam podlega według umowy. W związku z tym oraz w celu zapewnienia sprawnego wykonania usługi Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie powierzenia przetwarzania oraz dodanie zastrzeżenia (oraz wspomniany załącznik): „Wyjątek stanowią spółki powiązane i podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego z listy opisanej załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Lista może ulec zmianie, a na propozycję dodania nowych podmiotów Administrator ma prawo nie wyrazić zgody.” Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, to czy będzie korzystał z analizatorów w taki sposób, aby nie wprowadzać do nich danych osobowych

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Patrz zmiana nr 17.

Pytanie nr 39

Załącznik nr 10.3 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Par. 3 ust. 7 oraz par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zwolnienie z obowiązku dodatkowego upoważnienia swoich pracowników w przypadku oświadczenia o tym, że pracownicy ci są już upoważnieni do przetwarzania danych osobowych i zobowiązani do zachowania tajemnicy? Wykonawca oświadcza, że pracownicy Wykonawcy zostali przeszkoleni i zapoznani z zasadami przetwarzania danych osobowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 40

Załącznik nr 10.3 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Par. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia:

"a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Patrz zmiana nr 18.

Pytanie nr 41

Załącznik nr 10.3 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego zdania:

„Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42

Załącznik nr 10.3 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia? Ewentualnie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie przesłanek uprawniających do odstąpienia?

Odstąpienie od umowy bez wskazania jakiejkolwiek przyczyny powoduje narażenie Wykonawcy na straty, które Wykonawca może w kalkulować w cenę oferty co ostatecznie jest zjawiskiem niekorzystnym dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego postanowienia umowy.

Pytanie nr 43

Załącznik nr 10.3 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Par. 9 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 44

Załącznik nr 10.3 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Dot. par. 2.2 lit. E zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 48h w dni robocze

Odpowiedź:

Zamawiający nie znajduje wskazanego wyżej odniesienia w Załączniku Nr 10.3 do SWZ.

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający w przypadku przedłużającej się awarii powyżej 48h, wyrazi zgodę na wykonanie badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w przypadku przedłużającej się awarii powyżej 48 h wyrazi zgodę na wykonanie badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy. Patrz zmiana nr: 19

Pytanie nr 46

Załącznik nr 2.1 -2.6 do SWZ - Formularze asortymentowo-cenowe, pkt 32

"Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - 2 dni"

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje w powyższym zakresie zmiany treści SWZ poprzez usunięcie pkt. 32 w Załączniku Nr 2.2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Patrz: zmiana nr 4.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis czasu usunięcia awarii na: "2 dni robocze"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

Dot. pakietu 3

Prosimy o wskazanie dostawcy LIS w celu pozyskania dokładnej wyceny.

Odpowiedź:

Dostawcą LIS (Info -Medica) jest firma ASSECO POLAND S.A

Dotyczy Pakiet nr 1 – Dostawa odczynników do oznaczeń serologicznych mikrometodą kolumnową żelową wraz z dzierżawą analizatora i aparatury do mikrometody dla Brzeskiego Centrum Medycznego.

Pytanie nr 49

Czy w związku z zapisem zawartym w § 3 pkt 1 wzoru umowy dzierżawy (załącznik 3.2 do SWZ) Zamawiający dopuści wydanie dzierżawcy urządzenia w terminie do 30 dni roboczych ze względu na wydłużony czas oczekiwania na podłączenie analizatora do systemu LIS InfoMedica firmy ASSECO?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydanie urządzenia w terminie 30 dni. Szpital musi mieć zapewnioną ciągłość wykonywania badań laboratoryjnych, których nie wykona bez analizatora. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia urządzenia do sieci LIS do 14 dni od

dnia podpisania umowy. Jest to termin określony przez dostawcę LIS.

Pytanie nr 50

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie pakietu 1 kryteriami oceny ofert są Parametry techniczne określone w tabeli PARAMETRY OCENNE w załączniku nr 2.1 do SWZ, a Zamawiający dokona modyfikacji rozdziału XII SWZ Kryteria oceny ofert w zakresie pakietu 1?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Zał. Nr 2.1 do SWZ poprzez usunięcie omyłkowo tam zapisanych PARAMETRÓW OCENNYCH. Nie stanowią one kryteriów oceny ofert. W zakresie kryteriów oceny ofert w treści Działu XII SWZ nie dochodzi zatem do żadnych zmian. Patrz zmiana nr 8.

Pytanie nr 51

Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej, m. in. krwinki wzorcowe, Zamawiający dopuści w pakiecie 1 dostawy oferowanego asortymentu wg załączonego do oferty / dostarczanego raz w roku harmonogramu dostaw na dany rok z zapewnieniem dostaw pilnych w trybie cito do 4 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że rezygnuje z harmonogramu dostaw na dany rok w ramach pakietu nr 1. Powyższe wynika z faktu, że jednym z kryteriów oceny ofert obowiązujących w Pakiecie nr 1 jest „termin dostawy zamówienia.” Zamawiający wymaga, aby odczynniki dostarczane były w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze.

II. ZMIANY TREŚCI SWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) dokonuje następujących zmian treści SWZ:

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 4):

W Zał. Nr 2.3 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy, w poz. 22 - PARAMETRY TECHNICZNE I UŻYTKOWE BEZWZGLĘDNI WYMAGANE DLA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO Z ROZDZIAŁEM NA 5 POPULACJI, Zamawiający dokonuje zmiany zapisu poprzez ujednolicenie zapisu z poz. 22 do treści § 2 pkt. 2 lit. c) Zał. Nr 10.2 do SWZ – wzór umowy dzierżawy.

Nowy zapis w poz. 22 Zał. Nr 2.3 do SWZ otrzymuje brzmienie:

„Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 48 godzin w dni robocze. Czas ten rozumie się jako czas od zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu, przy czym czas reakcji na podjęcie naprawy wynosi do 24 godzin w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia.”

Zmiana nr 2 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 5):

W Zał. Nr 2.3 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy, w poz. 23 - PARAMETRY TECHNICZNE I UŻYTKOWE BEZWZGLĘDNI WYMAGANE DLA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO Z ROZDZIAŁEM NA 5 POPULACJI, Zamawiający dokonuje zmiany zapisu poprzez ujednolicenie zapisu z poz. 23 do treści § 2 pkt. 2 lit. c) Zał. Nr 10.2 do SWZ – wzór umowy dzierżawy.

W poz. 23 Zał. Nr 2.3 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy jest:

„Dostarczenie urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze - na czas naprawy powyżej 48 godzin.”

Winno być:

„Dostarczenie urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze - na czas naprawy powyżej 48 godzin **w dni robocze.**”

Zmiana nr 3 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 8):

W §3 ust. 1 lit. i) Zał. Nr 10.3 do SWZ - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisu poprzez dodanie sformułowania w brzmieniu:

„wyłącznie w zakresie danych dotyczących realizacji umowy Głównej, których Powierzający jest Administratorem”.

Wskutek dokonanej zmiany zapis §3 ust. 1 lit. i) Zał. Nr 10.3 do SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„wyłącznie w zakresie danych dotyczących realizacji umowy głównej, których Powierzający jest Administratorem, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Procesora danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Procesora, a także o wszelkich planowanych - o ile są mu wiadome - lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania przez tego Procesora danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Poinformowanie następuje w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 3 zdanie drugie.”

Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następujących przypadkach odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia w Zał. Nr 2.1-2.6 do SWZ – formularze asortymentowo-cenowe ti:

Zmiana nr 4

W Zał. Nr 2.2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy, w poz. 31 PARAMETRY (WYMAGANIA) TECHNICZNE I UŻYTKOWE DLA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO, Zamawiający dokonuje zmiany zapisu poprzez ujednolicenie zapisu z poz. 31 do treści § 2 pkt. 2 lit. c) Zał. Nr 10.2 do SWZ – wzór umowy dzierżawy.

Nowy zapis w poz. 31 Zał. Nr 2.2 do SWZ otrzymuje brzmienie:

„Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 48 godzin w dni robocze. Czas ten rozumie się jako czas od zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu, przy czym czas reakcji na podjęcie naprawy wynosi do 24 godzin w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia.”

Jednocześnie Zamawiający w poz. 31 usuwa zapis: „Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy – 24 godziny” oraz usuwa zapis w poz. 32.

W wyniku usunięcia całkowicie poz. 32, zmienia się numeracja kolejnych punktów odnoszących się do tabeli PARAMETRY (WYMAGANIA) TECHNICZNE I UŻYTKOWE DLA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO.

Zmiana nr 5

W Zał. Nr 2.2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy, w poz. 36 odnoszącej się do dzierżawy sprzętu, Zamawiający dokonuje zmiany treści przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację z dzierżawy wskazanego w poz. 36 zestawu komputerowego all in one (o parametrach nie gorszych niż :Procesor I5, 8GB RAM, dysk SSD lub równoważny).

Tym samym usunięciu ulega zapis znajdujący się w poz. 36 tabeli PARAMETRY (WYMAGANIA) TECHNICZNE I UŻYTKOWE DLA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO w brzmieniu: “W związku z dzierżawą sprzętu komputerowego, który będzie uczestniczył w obrocie danymi wrażliwymi, w celu ochrony danych osobowych jak i danych wrażliwych, Zamawiający wymaga przeniesienia prawa własności do dysku twardego po upływie terminu obowiązywania umowy.”

W wyniku usunięcia całkowicie poz. 36, zmienia się numeracja kolejnych punktów odnoszących się do tabeli PARAMETRY (WYMAGANIA) TECHNICZNE I UŻYTKOWE DLA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO.

Zmiana nr 6

W Zał. Nr 2.2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy, w “Objaśnieniach” znajdujących się pod tabelą formularza asortymentowo-cenowego Zamawiający dokonuje zmiany zapisu, ze względu na błędne odniesienie do poz. 33 zamiast do poz. 34.

Jest:

“Wykonawca w pozycji 33 powinien zaoferować wszystkie odczynniki i akcesoria nie wymienione przez Zamawiającego, a niezbędne do wykonania podanej ilości oznaczeń w okresie 36 miesięcy oraz dokonać ich wyceny. Przy szacowaniu ilości osocza kontrolnego należy przyjąć, że badania kontrolne dla wszystkich parametrów będą wykonywane codziennie na dwóch poziomach.”

Winno być :

*„Wykonawca **w pozycji 34** powinien zaoferować wszystkie odczynniki i akcesoria nie wymienione przez Zamawiającego, a niezbędne do wykonania podanej ilości oznaczeń w okresie 36 miesięcy oraz dokonać ich wyceny. Przy szacowaniu ilości osocza kontrolnego należy przyjąć, że badania kontrolne dla wszystkich parametrów będą wykonywane codziennie na dwóch poziomach.”*

Zmiana nr 7

W Zał. Nr 2.3 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy, w poz. 24 - PARAMETRY TECHNICZNE I UŻYTKOWE BEZWZGLĘDNI WYMAGANE DLA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO Z ROZDZIAŁEM NA 5 POPULACJI Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisu **poprzez usunięcie słów “dołączyć do oferty”**. Zapis zmienia się z:

“Instrukcja obsługi analizatora potwierdzająca parametry techniczne i użytkowe oferowanego aparatu oraz oprogramowania w języku polskim - dołączyć do oferty.”

na następujący:

“Instrukcja obsługi analizatora potwierdzająca parametry techniczne i użytkowe oferowanego aparatu oraz oprogramowania w języku polskim.”

Zmiana nr 8 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 50)

W Zał. Nr 2.1 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy, Zamawiający dokonuje zmiany poprzez **usunięcie tabeli: PARAMETRY OCENIANE** znajdującej się pod tabelą **PARAMETRY TECHNICZNE**.

Zmiana nr 9 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 10)

Zamawiający w **Dziale VI pkt. 4 SWZ** dokonuje zmiany w zakresie **wydłużenia terminu protokolarnego przekazania analizatorów z: 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na: 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

Jednocześnie zmianie ulega:

• **zapis § 3 ust. 1 wzoru umowy dzierżawy (Zał. Nr 10.2 do SWZ) z:**

„Strony wspólnie uzgadniają, że Wypodzierżawiający wyda Dzierżawcy urządzenia objęte przedmiotem umowy w terminie 7 dni liczonych od dnia podpisania niniejszej umowy w siedzibie Dzierżawcy przy ul. Mossora 1 , 49-301 Brzeg.”

na następujący:

*„Strony wspólnie uzgadniają, że Wypodzierżawiający wyda Dzierżawcy urządzenia objęte przedmiotem umowy w terminie **14 dni kalendarzowych** liczonych od dnia podpisania niniejszej umowy w siedzibie Dzierżawcy przy ul. Mossora 1 , 49-301 Brzeg;”*

• **zapis pkt. 4 lit. b) formularza oferty (Zał. Nr 1 do SWZ) z:**

*“Termin protokolarnego dostarczenia, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu analizatora/-ów: **do 7 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy.”*

na następujący:

*“Termin protokolarnego dostarczenia, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu analizatora/-ów: **do 14 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy.”*

Zmiana nr 10 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 17)

W Zał. Nr 2.2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy, w poz. 28 PARAMETRY (WYMAGANIA) TECHNICZNE I UŻYTKOWE DLA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO, Zamawiający dokonuje zmiany opisu wymagania z:

„Możliwość czytania barkodów z próbek i odczynników”

na następujący:

„Możliwość czytania barkodów z próbek i odczynników z kodów RFID.”

Zmiana nr 11 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 18)

W § 2 ust. 5-7 projektowanych postanowień umowy (Zał. Nr 10.1 do SWZ) Zamawiający dokonuje zmian

poprzez **zamianę słów “dni” na “dni robocze”**.

Zmiana nr 12 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 26)

W § 9 ust. 2 pkt 4) i 5) projektowanych postanowień umowy (Załącznik Nr 10.1 do SWZ) Zamawiający dokonuje zmian poprzez **zamianę słów “dni” na “dni robocze”**.

Zmiana nr 13 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 31)

W § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy dzierżawy (Załącznik Nr 10.2 do SWZ) Zamawiający dokonuje zmiany zapisu z:

„Wydzierżawiający zobowiązuje się zapłacić Dzierżawcy kary umowne:

- 1) z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wydzierżawiający ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10,00% łącznej wartości przedmiotu umowy netto”

na następujący:

„Wydzierżawiający zobowiązuje się zapłacić Dzierżawcy kary umowne:

- 1) z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wydzierżawiający ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10,00% **niezrealizowanej** wartości przedmiotu umowy netto”

Jednocześnie zmianie ulega zapis § 7 ust. 3 umowy dzierżawy z :

„Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić Wydzierżawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Dzierżawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10,00% łącznej wartości przedmiotu umowy netto, za wyjątkiem przypadków określonych w umowie oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.”

na następujący:

„Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić Wydzierżawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Dzierżawca ponosi odpowiedzialność, **w wysokości 10,00% niezrealizowanej wartości** przedmiotu umowy netto, za wyjątkiem przypadków określonych w umowie oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.”

Zmiana nr 14 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 35)

W § 11 ust. 2 wzoru umowy dzierżawy (Załącznik Nr 10.2 do SWZ) Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SWZ.

W ust. 2 po lit. b) zostaje wprowadzony następujący zapis:

„ **c) w kontekście zmiany wysokości ceny miesięcznego czynszu dzierżawnego, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, w wyniku waloryzacji. Jeżeli zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przekroczy 10% według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny ze skutkiem na dzień 1 czerwca następnego roku kalendarzowego obowiązywania umowy i wzrost ten ma wpływ na wysokość wynagrodzenia za realizację umowy, każda ze stron może wystąpić o zmianę wynagrodzenia za realizację umowy:**

- **maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 30% pierwotnej wartości umowy,**
- **zmiana wynagrodzenia związana ze wzrostem cen kosztów może zostać dokonana po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia, które zostało zapłacone, zgodnie z warunkami umowy przed ww. terminem (tj. w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy).”**

Jednocześnie zmianie ulega **§ 11 ust. 3 wzoru umowy dzierżawy, który otrzymuje brzmienie:**

„Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 2 lit. a) **i c)** następować będzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty realizacji umowy oraz określeniem stopnia, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.”

oraz

§ 11 ust. 6 wzoru umowy dzierżawy, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę umowy na podstawie o której mowa w ust. 2 lit. b) i c), z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowych zapisów.”

Zmiana nr 15

W § 11 wzoru umowy dzierżawy (Załącznik Nr 10.2 do SWZ) Zamawiający dokonuje **usunięcia treści ust. 5.**

Wskutek usunięcia ust. 5 zmienia się numeracja kolejno następujących ustępów.

Zmiana nr 16 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 36)

W § 11 ust. 2 lit. a) wzoru umowy dzierżawy (Załącznik Nr 10.2 do SWZ) Zamawiający dokonuje zmiany poprzez **zamianę słów “dni” na “dni robocze”.**

Zmiana nr 17 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 38)

Zamawiający w § 3 ust. 2 Załącznik Nr 10.3 do SWZ – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, dokonuje następującej modyfikacji ust. 2 :

Było:

„Jeżeli powierzone dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach i nośnikach danych Procesora, te serwery i nośniki nie mogą znajdować się poza obszarem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.”

Wskutek dokonanej zmiany jest:

„Jeżeli powierzone dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach i nośnikach danych Procesora, te serwery i nośniki nie mogą znajdować się poza obszarem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. **Wyjątek stanowią spółki powiązane i podwykonawcy podmiotu przetwarzającego (Procesora) z listy opisanej załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Lista może ulec zmianie, a na propozycję dodania nowych podmiotów Administrator ma prawo nie wyrazić zgody.**”

Zmiana nr 18 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 40)

Zamawiający w § 4 ust. 1 Załącznik Nr 10.3 do SWZ – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, dokonuje zmiany treści poprzez **dodanie w ust. 1 następujących podpunktów:**

- “a) Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Administratora danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Procesora, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Procesora środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.**
- b) Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Procesora.**
- c) Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Procesora.**
- d) Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Procesora, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Procesora.”**

Zmiana nr 19 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 45)

Zamawiający w § 2 ust. 2 Załącznik Nr 10.2 do SWZ (Wzór umowy dzierżawy) dokonuje zmiany polegającej na dodaniu zapisu w następującym brzmieniu:

„f) wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wydierżawiającego w przypadku przedłużającej się awarii pow. 48 godzin.”

Zmiana nr 20

Zamawiający dokonuje **zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w pkt. 2.1 Procedura/Opis** polegającej na modyfikacji pierwszego zdania opisu **z:**

„Przedmiotem zamówienia jest **dostawa odczynników do oznaczeń serologicznych mikrometodą kolumnową żelową wraz z dzierżawą aparatury i sprzętu komputerowego, dostawa odczynników do modułu biochemicznego zintegrowanej platformy biochemiczno- immunochemicznej wraz z**

jej dzierżawą, dostawa odczynników do analizatora hematologicznego wraz z jego dzierżawą oraz dostawa odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej NA, K, CL, Ca zjonizowanego z kooksymetria wraz z dzierżawą analizatora do Laboratorium, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

na następujący:

*„Przedmiotem zamówienia jest **dostawa odczynników do oznaczeń serologicznych mikrometodą kolumnową żelową wraz z dzierżawą analizatora immunohepatologicznego do wykonywania badań z zakresu grup krwi i badań przeglądowego przeciwciał oraz aparatury do mikrometody**, dostawa odczynników do modułu biochemicznego zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej wraz z jej dzierżawą, dostawa odczynników do analizatora hematologicznego wraz z jego dzierżawą oraz dostawa odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej NA, K, CL, Ca zjonizowanego z kooksymetria wraz z dzierżawą analizatora do Laboratorium, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”*

Zamawiający informuje, że **zmieniona SWZ wraz z zmodyfikowanymi Załącznikami: Zał. Nr 1 do SWZ – Formularzem oferty, Zał. Nr 2.1- 2.6 do SWZ – formularzami asortymentowo-cenowymi, Zał. Nr 10.1 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, Zał. Nr 10.2 do SWZ – wzór umowy dzierżawy, Zał. Nr 10.3 do SWZ – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych**, zostanie opublikowana na stronie prowadzonego postępowania: <https://e-ProPublico.pl/> w zakładce: **Dokumenty zamówienia**. Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje, jako **stanowiące integralną część SWZ**.

Jednocześnie Zamawiający, w celu zapoznania się Wykonawców z dokonanymi zmianami treści SWZ i rzetelnego przygotowania ofert, działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp, **przedłuża terminy:**

- **składania ofert** – z dnia 17 września 2024 r., godz.:09:30 na dzień: **20 września 2024 r., godz.: 09:30;**
- **otwarcia ofert** – z dnia 17 września 2024 r., godz.: 10:00 na dzień: **20 września 2024 r., godz.: 10:00;**
- **terminu związania z ofertą** z :15 grudnia 2024 r. na dzień: **18 grudnia 2024 r.**

Zgodnie z art. 135 ust. 6 oraz 137 ust. 2 ustawy Pzp stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

.....
Kierownik Zamawiającego