

PZP-225/19/2023

Korfantów dnia: 21.11.2023 r.

## **ODPOWIEDZI** na pytania

**Dotyczy postępowania na: Sukcesywną dostawę sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku.**

Zamawiający przekłada wyjaśnienia będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

**Pytanie nr 1:**

**Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepyłającej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kalafonii. Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Długość rozmiaru XXL 140 cm (+/- 2 cm) Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka, z tyłu zapięcie na rzep (12cm x 2,5cm i 6cm x 2,5cm). Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem (min. 8 cm). Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową. Zgodność z normą EN-13795 1-3. Na opakowaniu jednostkowym etykieta główna zawierająca nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO, dane producenta, datę produkcji, datę ważności, temperatury przechowywania. Dodatkowo 3 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji, etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, datę produkcji i kod kreskowy. Posiada oznakowanie rozmiaru literowo XXL w formie nadruku na fartuchu oraz serwecie. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki w rozmiarze ok. 30 x 40 cm. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu, wewnętrzne opakowanie serweta włókninowa?

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 2:**

**Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepyłającej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kalafonii. Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Długość rozmiaru XXL 140 cm (+/- 2 cm) Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka, z tyłu zapięcie na rzep (12cm x 2,5cm i 6cm x 2,5cm). Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem (min. 8 cm). Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową. Zgodność z normą EN-13795 1-3. Na opakowaniu jednostkowym etykieta główna zawierająca nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO, dane producenta, datę produkcji, datę ważności, temperatury przechowywania. Dodatkowo 3 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji, etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, datę produkcji i kod kreskowy. Posiada oznakowanie rozmiaru literowo XXL w formie nadruku na fartuchu oraz serwecie. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki w rozmiarze ok. 30 x 40 cm. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu, wewnętrzne opakowanie papier krepowy?

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 3:**

**Pakiet 2, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w kolorze niebieskim, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep 12cm x 2,5cm i 6cm x 2,5cm?

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 4:**

**Pakiet 2, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny posiadający oznakowanie rozmiaru literowo w formie nadruku na fartuchu oraz serwecie?

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 5:**

**Pakiet 2, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny którego etykieta główna zawierająca nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO, dane producenta, datę produkcji, datę ważności, temperatury przechowywania. Dodatkowo 3 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji, etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, datę produkcji i kod kreskowy?

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 6:**

**Pakiet 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL o długości 135 cm (+/- 2 cm)?

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 7:**

**Pakiet 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze XXL o długości 140 cm (+/- 2 cm)?

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 8:**

**Pakiet 2**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymagania zawarte pod tabelą dot. naklejek mają odnosić się do pozycji 1 i 2?

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 9:**

**Pakiet 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści komplet zabiegowy o gramaturze 40g/m2?


**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 10:**

**Pakiet 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra, jałowy o poniższym składzie:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup>
- Zgodność z normą PN-EN 13795
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta 75 x 90cm;
- 1 serweta 150 x 200cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 120cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma przylepna 5 x 120cm;
- 1 serweta główna 200 x 300cm, z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma przylepna wokół wycięcia;
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;

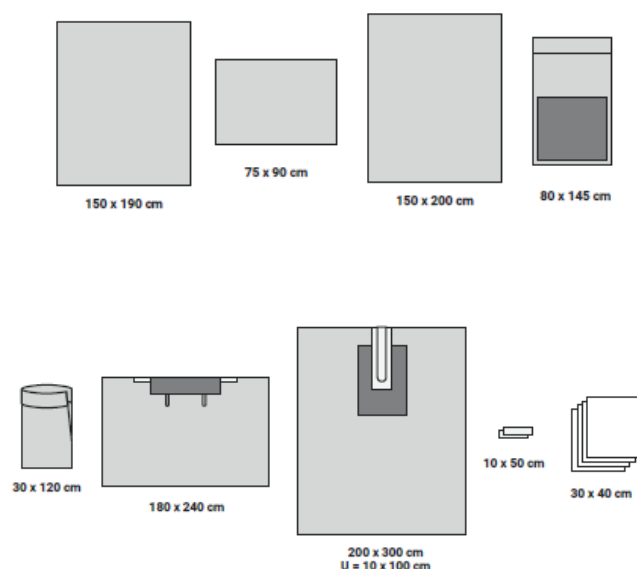


**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 11:

#### Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny, jałowy o poniższym składzie:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65 g/m<sup>2</sup>
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;
- 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

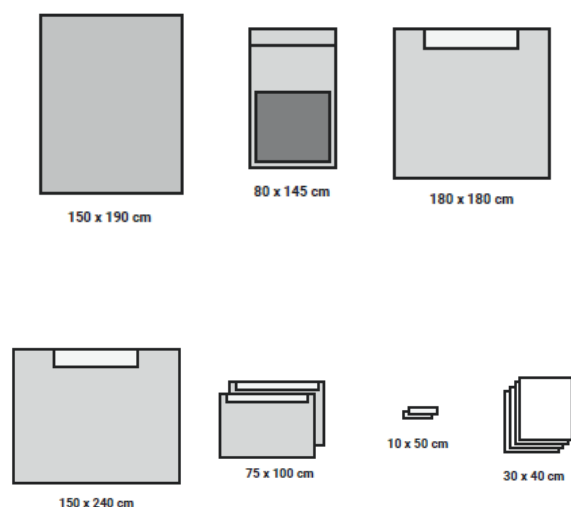

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 12:**


**Pakiet 3, pozycja 3, 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyn, jałowy o poniższym składzie:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup>
- Zgodność z normą PN-EN 13795
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 90 cm;
- 1 serweta główna 230 x 320 cm, z samouszczelniającym otworem (Ø 7 cm) i padem chłonnym 50 x 50 cm wokół otworu.

Dodatkowo 2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.

- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

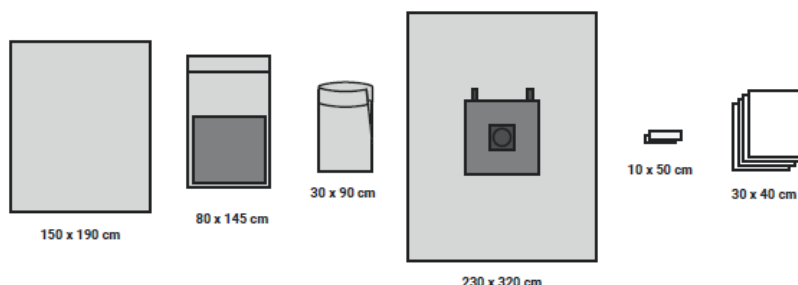

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 13:**

**Pakiet 3, pozycja 4-5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyn, jałowy o poniższym składzie:


- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup>
- Zgodność z normą PN-EN 13795
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta 100 x 150 cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 90 cm;
- 1 foliowa osłona na przewody 15 x 250 cm;
- 1 serweta główna 200 x 300 cm ze zintegrowanym trójkątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów. Zbiornik wyposażony w kształtkę

(szybownik), samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm i zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka.

Dodatkowo 3

zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;

- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50 cm

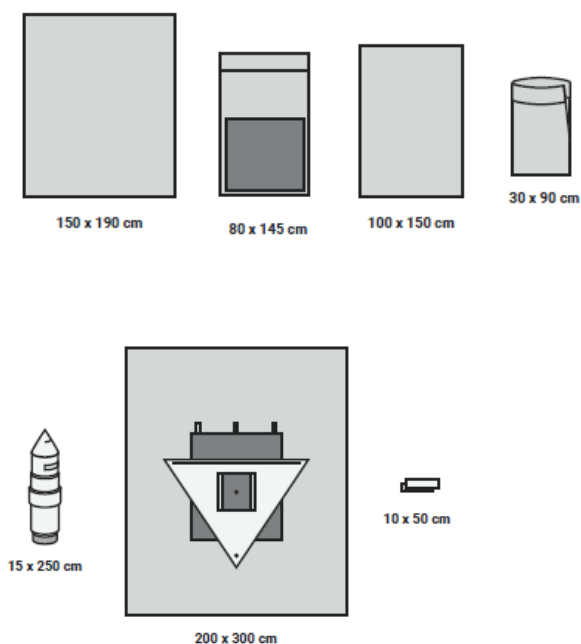

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 14:**

**Pakiet 3, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści ręczniki, jałowe o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, standardowe opakowanie zbiorcze ?

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 15:**

**Pakiet 3, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści osłonę, jałową w rozmiarze 14 x 250 cm, standardowe opakowanie zbiorcze 250 szt.?

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 16:**

**Pakiet 3, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo, jałowy o poniższym składzie:

- Osłona wykonana z folii polietylenowej
- Wzmocnienie włókninowe części roboczej (rozmiar 145cm x 59cm)
- Rozmiar 80 x 145 cm
- Składana teleskopowo, osłona z wywinieciem zewnętrznym przedniej części tworzącym mankiet.
- Zgodność z normą PN-EN 13795A1:2013-06

Standardowe opakowanie zbiorcze?

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 17:**

**Pakiet 3, pozycja 9 -10**

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup>, standardowe opakowanie zbiorcze?

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 18:**

**Pakiet 3, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym owalnym 5 x 6 cm, standardowe opakowanie zbiorcze?  
**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 19:**

**Pakiet 3, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym owalnym 6 x 8 cm, o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup>, standardowe opakowanie zbiorcze 450 szt.?


**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 20:**

**Pakiet 3, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści zestaw, jałowy o poniższym składzie:

- Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni
- Gramatura 83 g/m<sup>2</sup>
- Osłona Mayo ze wzmocnieniem
- Zgodność z normą PN-EN 13795
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm);
- 1 serweta główna 200 x 260cm z otworem 20 x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, otwór otoczony łatą chłonną o wymiarze 70 x 100 cm z dwoma organizatorami przewodów w formie rzepów, zintegrowany zbiornik do przechwytywania płynów w kształcie trójkąta wyposażony w kształtkę (szytnik) oraz 1 zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka.

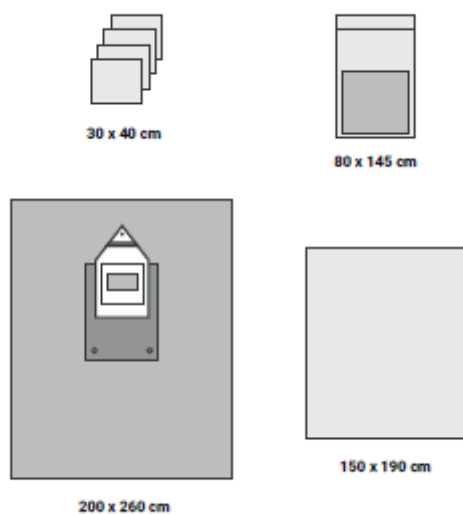

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.


**Pytanie nr 21:**

**Pakiet 3, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii, jałowy o poniższym składzie:

- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni
- Gramatura 62g/m<sup>2</sup>
- Zgodność z normą PN-EN 13795
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 włókninowa OP taśma 9 x 49cm;

- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 25 x 65cm;
- 1 serwetka na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 serwetka 150 x 150cm;
- 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm;
- 1 serwetka główna 205x 320cm z otworem, otoczonym łata chłonną, zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (szybownik), zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka; 3 zintegrowane z serwetką organizatory przewodów w formie rzepów.

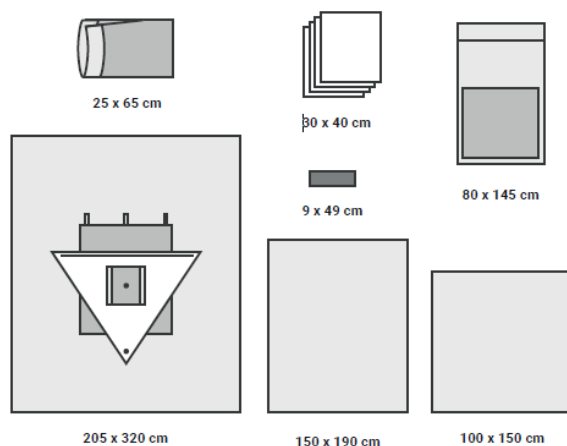

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

### **Pakiet 3, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści serwetkę z otworem przylepnym owalnym 6 x 8 cm, standardowe opakowanie zbiorcze 300 szt.?

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 22:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 1 dopuści wycenę igieł o ścianie standardowej/normalnej dla rozm. 0,33x12, 0,45x12, 0,45x22?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 23:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 4, 5 dopuści wycenę igieł o ścianie standardowej/normalnej?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 24:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 1-12 wymaga wyceny produktów jednego producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 25:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 9-12 dopuści wycenę strzykawki wykonanej w całości z polipropylenu?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 26:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 13 dopuści wycenę strzykawek trzyczęściowych do pomp infuzyjnych firmy Margomed 50 (60ml), kompatybilnych z wszystkimi pompami infuzyjnymi dostępnymi na rynku oraz powszechnie stosowanymi w placówkach służby zdrowia?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 27:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 15 dopuści wycenę strzykawki do insuliny z wbudowaną igłą 0,30x12,7mm?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 28:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 18 wymaga wyceny 1op. x100szt. czy 100op. x100szt.?

**Odpowiedź:** Wycena 100 op. po 100 sztuk.

**Pytanie nr 29:**

**Pakiet nr 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ortopedycznych o składzie:

1. uchwyt rozbudowany z filtrem; średnica wejścia ok. 9/11mm; długość ok. 21cm; filtr perforowany o średnicy ok. 16,5/19mm
2. dodatkowy filtr perforowany
3. końcówka ssąca długa zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 23cm
4. końcówka ssąca krótka zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 15cm
5. końcówka ssąca prosta o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 28cm
6. dren z końcówką lejek / lejek cut-to-fit o średnicy 5/8mm i długości 200cm?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 30:**

**Pakiet nr 8, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę podwójnie zagiętą?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 31:**

**Pakiet nr 8, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści przezroczystą końcówkę?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 32:**

**Pakiet nr 8, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę z niewielką zawartością ftalanów?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 33:**

**Pakiet nr 8, pozycja 2**



Czy Zamawiający dopuści końcówkę o średnicy 4,13 / 7,51mm?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 34:**

**Pakiet nr 8, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o długości 27cm?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 35:**

**Pakiet nr 8, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1m?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 36:**

**Pakiet nr 8, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści łącznik o średnicy 5/8mm?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 37:**

**Pakiet nr 8, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści łącznik o średnicy 8/10mm?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 38:**

**Pakiet nr 8, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy wew. 5mm?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 39:**

**Pakiet nr 8, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1m?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 40:**

**Pakiet nr 8, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy wew. 5mm?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 41:**

**Pakiet nr 8, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1m?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 42:**

**Pakiet nr 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 2m?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 43:**

**Pakiet nr 9, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z medycznego PCV, bez ftalanów?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 44:**

**Pakiet nr 9, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści maskę dla dorosłych w rozmiarach L i XL?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 45:**

**Pakiet nr 9, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści maskę posiadającą 2 otwory wentylacyjne po bokach?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 46:**

**Pakiet nr 9, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści maskę z blaszką w części nosowej?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 47:**

**Pakiet nr 9, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści maskę pakowaną zbiorczo po 100 sztuk?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 48:**

**Pakiet nr 9, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści rurkę Guedel w rozmiarze 5 o dł. 11cm w kolorze pomarańczowym, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 49:**

#### **Pakiet nr 9, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści rurkę Guedel w rozmiarze 6 o dł. 12cm w kolorze fioletowym w zamian za nr 5, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 50:**

##### **Pakiet nr 9, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonana z PCV, bez lateksu, posiadająca łukowaty kształt, rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, dren wbudowany w mankiet, rozmiar, zakres wagi i objętość mankieta oznaczone na tubusie maski, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii maski. Dostępne rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5. Kolorowe zabezpieczenie umożliwiające szybką identyfikację rozmiaru maski (1 – różowy; 1,5 -niebieski; 2 – czarny; 2,5 - biały; 3 – zielony; 4 – żółty; 5 – czerwony). Maksymalna objętość mankieta: 1 – 4ml; 1,5 – 7ml; 2 – 10ml; 2,5 – 14ml; 3 – 20ml; 4 – 30ml; 5 – 50ml. Maski sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu jednostkowym graficzna i opisowa instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 51:**

##### **Pakiet nr 9, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak
- Możliwość stosowania przez 24h?



**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 51:**

##### **Pakiet nr 9, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarach:

ROZMIAR	PRZEZNACZENIE
1	niemowlę
2	dziecko
3	dorosły S / dziecko
4	dorosły M
5	dorosły L
6	dorosły XL

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 53:**

**Pakiet nr 9, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 54:**

**Pakiet nr 9, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści równoważny zestaw do nebulizacji?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 55:**

**Pakiet nr 9, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator rozpylający cząsteczki o średnicy 5 mikronów o wydajności nebulizacji 0,2 ml / min - 1,4 ml w 7 minut i frakcji respirabilnej (cząsteczki <5 um) - 79.7% (+/-1.7%), MMAD – 2,0-2,2µm?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 56:**

**Pakiet nr 9, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 57:**

**Pakiet nr 9, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści linie o średnicy 1,8mm / 3,0mm?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 58:**

**Pakiet nr 9, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści linie wykonaną wyłącznie z PCV?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 59:**

**Pakiet nr 9, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści linie pakowaną zbiorczo po 100 sztuk?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 60:**

**Pakiet nr 9, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści obwód z 2 rurami rozciągliwymi do 1,8m, z 1 rurą dodatkową o długości po rozciągnięciu – 1,2m?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 61:**

**Pakiet nr 9, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści obwód nie posiadający systemu Twist Lock?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 62:**

**Pakiet 1** – Czy Zamawiający dopuści jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMMS o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny o szerokości nie mniejszej niż 8 cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonane z materiału spunlace o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm.

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 63:**

**Pakiet 1** – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby 2 wklejki zawierały kod QR?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 64:**

**Pakiet 2 pozycja 1, 2** – Czy Zamawiający dopuści jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMMS o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, kolor niebieski. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny o szerokości nie mniejszej niż 8 cm. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania.

**Odpowiedź.** Tak. Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 65:**


**Pakiet 3 poz. 1-8, 13-15** – Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie zestawów sterylizowanych radiacyjnie?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 66:**

**Pakiet 3 pozycja 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

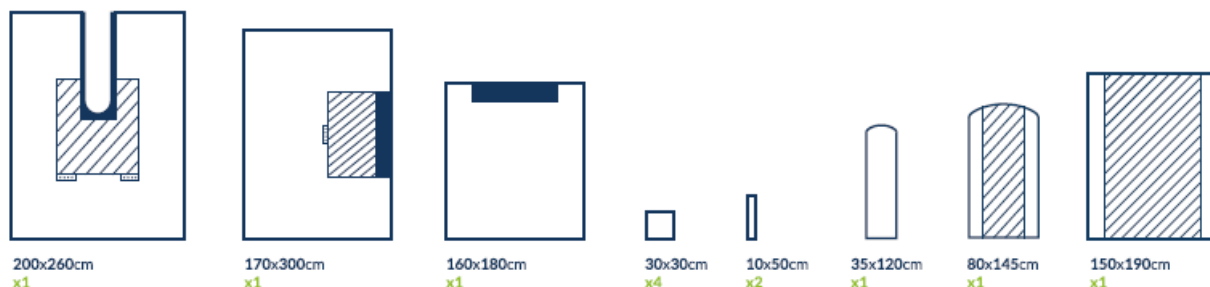

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 67:**

**Pakiet 3 pozycja 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami wykonanymi z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów. Wytrzymałość na wypychanie na sucho w obszarze krytycznym 205.6 kPa. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa.


**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 68:**

**Pakiet 3 pozycja 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

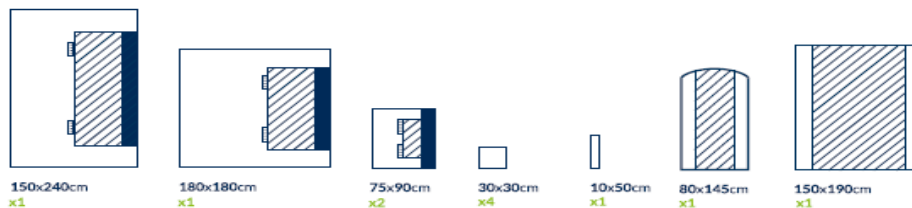

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 69:


**Pakiet 3 pozycja 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami wykonanymi z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość na wypychanie na sucho w obszarze krytycznym 180 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O.

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 70:

**Pakiet 3 pozycja 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

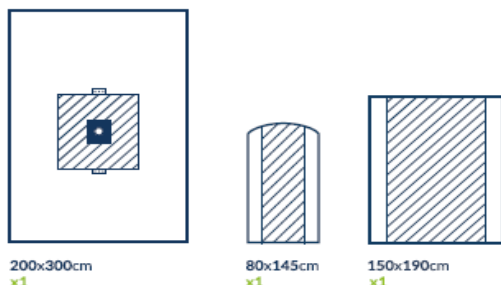

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 71:

**Pakiet 3 pozycja 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami wykonanymi z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów. Wytrzymałość na wypychanie na sucho w obszarze krytycznym 205.6 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O.

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 72:

**Pakiet 3 pozycja 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 73:**


**Pakiet 3 pozycja 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami wykonanymi z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość na wypychanie na sucho w obszarze krytycznym 180 kPa. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 74:**

**Pakiet 3 pozycja 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

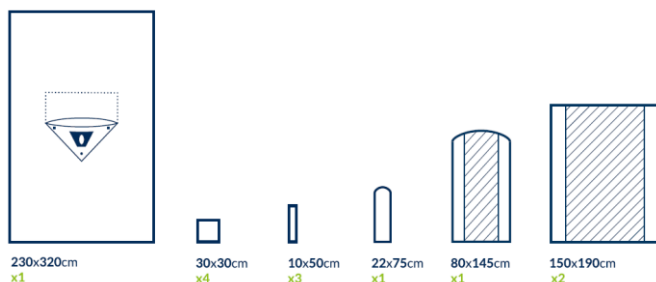

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 75:**

**Pakiet 3 pozycja 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami wykonanymi z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość na wypychanie na sucho w obszarze krytycznym 110 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H<sub>2</sub>O.

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 76:**

**Pakiet 3 pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetkę chłonną o wymiarach 40cm x 40cm, wykonana z wysokochłonnej włókniny typu spunlace o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 77:**



**Pakiet 3 pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści serwetkę w opakowaniu a'1 szt (papier-folia)

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 78:**

**Pakiet 3 pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody wyposażoną z jednej strony w końcówkę z perforacją umożliwiającą wysunięcie przewodu, a z drugiej wyposażony w kartonik z oznakowaniem kierunku rozwijania osłony oraz 2 taśmy przylepne o wymiarach 2,5cm x 17cm. Osłona z przezroczystej folii polietylenowej 0.05 mm. Składana teleskopowo.

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 79:**

**Pakiet 3 pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 14x250cm?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 80:**

**Pakiet 3 pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 81:**

**Pakiet 3 pozycja 9, 10, 12** – Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 82:**

**Pakiet 3 pozycja 9, 10, 12** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o odporności na wypychanie na sucho 109 kPa, Odporność na penetrację płynów 196 cm<sup>2</sup> H<sub>2</sub>O

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 83:**

**Pakiet 3 pozycja 9, 10, 11, 12** – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby serwety zapakowane były w kartonowy dyspenser?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 84:**

**Pakiet 3 pozycja 11** – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem 6x8cm?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 85:**

**Pakiet 3 pozycja 11** – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm z otworem 6x8cm?


**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 86:**

**Pakiet 3 pozycja 13** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1x serweta o wymiarach 340cm x 240cm z czterema samoprzylepnymi paskami wzdłuż górnej krawędzi o wymiarach 3,5cm x 60 cm, posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 30cm x 80cm wypełniony folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wyposażoną w sztywnik, filtr oraz port umożliwiający podłączenie drenów o różnej średnicy. Dodatkowo, wyposażona w dwie dwukomorowe kieszenie o wymiarach 40cm x 30cm oraz dwie taśmy typu rzep o wymiarach 2cm x 12cm

- 4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,
- 1 x osłona na stół Mayo 80cm x 145cm,
- 1 x serwetka na stół instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm.

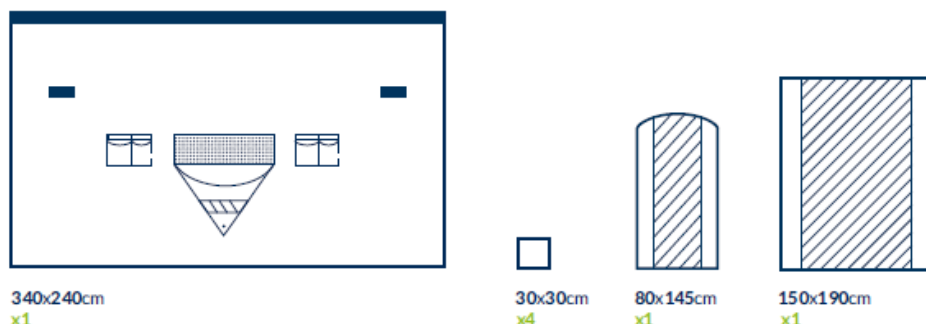

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 87:**


**Pakiet 3 pozycja 13** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki głównej wykonanej z transparentnej folii PE o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 88:**

**Pakiet 3 pozycja 14** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serwetka o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 80cm x 100cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serwetka) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serwetka wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

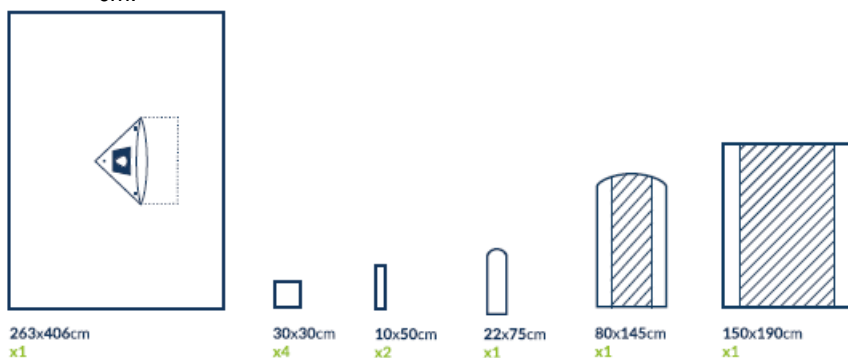

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 89:**

**Pakiet 3 pozycja 14** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki głównej wykonanej z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 90:**

**Pakiet 3 pozycja 15** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety z otworem 7 cm?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 91:**

**Pakiet 3 pozycja 15** – Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a'50szt?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 92:**

**Pakiet nr 5, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści matę podłogową umożliwiającą wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 7l wody, min. 3 litry soli fizjologicznej); dwustronna, chłonna od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; Warstwa wierzchnia i spódna wykonana z hydrofilnej włókny, w części środkowej superabsorbent; rozmiar 75x36cm (wkład chłonny 68cmx30cm), kolor biały; Pakowana zbiorczo w opakowanie a'100szt?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 93:**

**Pakiet nr 5, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadającą antypoślizgową warstwę spódnią, chłonność około 1 litr; 2 warstwy: biała warstwa bawełniana, niebieska warstwa antypoślizgowa z folii LDPE; rozmiar 116cm x 76cm. Pakowana zbiorczo w opakowanie a'50szt?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 94:**

**Pakiet nr 5, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści matę podłogową o parametrach:

- maty wchłaniają wszystkie płyny ustrojowe, oraz wszelkie inne płyny,
- warstwy wchłaniające gwarantują wysoką odporność na plamy po Betadine,
- umożliwiają pozbycie się nadmiaru płynów z podłogi w trakcie zabiegów z dużą ilością płynów,
- przylegają do podłogi umożliwiając przejazd np. wózków ze sprzętem lub łóżek bez ryzyka zwijania się maty lub jej rozdarcia,
- laminowana, nieprzemakająca warstwa spódna, eliminuje bezpośredni kontakt płynów z podłogą, nie pozostawia plam,
- bezłateksowe,
- rozmiar 117 cm x 183 cm
- absorpcja wody w litrach 4,5
- zdolność absorpcyjna w cm<sup>3</sup>/g 13,29
- opakowanie jednostkowe folia
- opakowanie zbiorcze 10szt

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 95:**

**Pakiet nr 7, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemann o poniższych właściwościach:

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie
- Atrajmatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika
- Wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Koniec dystalny zakończony stożkowato, zagięty pod kątem 45°
- Przezroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową
- Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier/folia

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 96:**

**Pakiet nr 7, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley o poniższych właściwościach:  
WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z miękkiego i elastycznego silikonu, który ogranicza reakcję alergiczną błon śluzowych i zwiększa komfort pacjenta
- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego
- Cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Uniwersalne zakończenie cewnika pasuje do standardowych łączników w workach na mocz
- Silikonowa powierzchnia pozwala na atraumatyczne wprowadzenie cewnika
- Kontrast RTG wzdłuż całej długości drenu
- Łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie
- Plastikowa zastawka zapewnia szczelność balonu
- Cewnik w rozmiarze CH 6, CH 8, CH 10 posiada nylonową prowadnicę ułatwiającą cewnikowanie
- Wewnątrz opakowania osobno pakowana zatyczka
- Wyrób nie zawiera ftalanów
- Wyrób nie zawiera lateksu
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne – wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 97:**

**Pakiet nr 7, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley pakowany 1 sztuka / wew. folia, zew. papier-folia  
**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 98:**

**Pakiet nr 7, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem dla rozmiaru CH 12-24 o pojemności 5-10ml oraz CH 24-28 30-50ml?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 99:**

**Pakiet nr 7, pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu o poniższych parametrach:

- worek o pojemności 2000ml wykonany z medycznego PVC
- biała, tylna ścianka ułatwiająca wizualną ocenę moczu
- skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
- szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką z możliwością podwieszenia w twardej pochewce
- komora kroplowa typu Pasteur'a tworząca „suchą” barierę powietrzną
- dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnątrz systemu
- dren długości 120 cm o dużej średnicy, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym
- samouszczelniający się, bezigłowy port do pobierania próbek na zakończeniu drenu
- dren wyposażony w przesuwny zacisk oraz zapinkę do stabilizacji drenu
- w miejscu połączenia drenu z komorą dodatkowy element wzmacniający zapobiegający zaginaniu i skręcaniu drenu
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml od 25 do 100 ml i co 100 ml od 100 do 2000 ml
- na worku nazwa producenta, miejsce do opisu danych pacjenta oraz daty
- zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka
- dodatkowe mocowanie za pomocą sznurka
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier-folia

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 100:**

**Pakiet nr 7, pozycja 11** - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy pakowany 1 sztuka/papier-folia?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 101:**

**Pakiet nr 11, pozycja 25** - Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 54mm?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 102:**

**Pakiet nr 11, pozycja 25** - Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod pakowanych a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 103:**

**Pakiet nr 12, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści koreczki dezynfekcyjne pakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym a`100szt?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 104:**

**Pakiet nr 12, pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec wykonany z włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy z perforacją na całej długości i szerokości ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek w rozmiarze 2,5cm x 9,14m?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 105:**

**Pakiet nr 12, pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści w miejsce opisanego w SWZ przylepiec/taśmę chirurgiczną, niejadalną, opatrunkową wykonaną z hydrofobowej włókniny poliestrowej z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym z klejem akrylowym. Taśma posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego z metryczną podziałką umożliwiającą precyzyjne dzielenie za pomocą nożyczek oraz przecięciem prostym lub falistym. Opakowanie: kartonik-dyspenser. Po oderwaniu wieczka możliwe jest wysuwanie taśmy bez jej wyjmowania z kartonika. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. Rozmiar 15 cm x 10 m?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 106:**

**Pakiet nr 14, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,50x20mm?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 107:**

**Pakiet nr 14, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści igły wyłącznie w rozmiarach 1,1x40 oraz 1,2x40mm?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 108:**

**Pakiet nr 14, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy IIa (wyższej niż oczekiwana)?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 109:**

**Pakiet nr 14, pozycja 6-8** - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem 10% wartości nominalnej?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 110:**

**Pakiet nr 14, pozycja 9-12** - Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzenia skali?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 111:**

**Pakiet nr 14, pozycja 12** - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki pakowanej a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 112:**

**Pakiet nr 14, pozycja 15** - Czy Zamawiający dopuści strzykawki w komplecie z niezintegrowaną igłą w rozmiarze 0,4x13mm?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 113:**

**Pakiet nr 14, pozycja 16** - Czy Zamawiający dopuści igły do penów w poniższych rozmiarach:

ROZMIAR

0,33 mm x 12 mm

0,30 mm x 8 mm

0,25 mm x 6 mm

0,25 mm x 8 mm ?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 114:**

**Pakiet nr 14, pozycja 17** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z filtrem hydrofilowym cząsteczkowy Liquid Lock o wielkości oczek 8 µm?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 115:**

**Pakiet nr 14, pozycja 17** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z filtrem zabezpieczającym przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm?

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 116:**

**Pakiet 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycji 1 igły iniekcyjnej 0,33x 12,5 mm zamiast 0,33x 12 mm

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 117:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycji 1 igły iniekcyjnej 0,45x 12,5 mm zamiast 0,45x 12 mm

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 118:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycji 1 igły iniekcyjnej 0,45x 16 mm zamiast 0,45x22mm

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 119:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycji 1 igły iniekcyjnej 0,50x 16mm lub 25mm do wyboru Zamawiającego zamiast 0,50x19 mm

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 120:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycji 1 igły w rozmiarze 0.6 x 32 mm zamiast 0,6 x 30 mm.

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 121:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycji 1 igły w rozmiarze 0.6 x 32 mm zamiast 0,6 x 40 mm.

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 122:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycji 1 igły w rozmiarze 0.7 x 32 mm zamiast 0,7 x 30 mm.

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 123:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycji 1 igły w rozmiarze 0,8x25mm zamiast 0,8x16mm

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 124:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycji 4 Igły tępej do bezpiecznego pobierania leków z fiolek 18G, 1,2 x 40mm, otworem centralny i ostrzem ściętym pod kątem 45°, z nasadką w kolorze czerwonym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań bez filtra cząsteczkowego. sterylizacja tlenkiem etylenu

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 125:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycji 6 Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę. Skala do 3 ml.

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 126:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycji 8 Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę. Skala do 12 ml

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 127:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycji 9 Strzykawkę 3-częściową , jałowa, końcówka luer-lock - 3 ml, tłok i cylinder z polipropylenu ,długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki,skalowanie co 0,1 ml,logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku , kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta , sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 128:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycji 10 strzykawki 3-częściowej , jałowa, końcówka luer-lock,- 5 ml, tłok i cylinder z polipropylenu,długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,2 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne,opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne),jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.



**Pytanie nr 129:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycji 11 strzykawki 3-częściowej, jałowa, końcówka luer-lock 10 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie 0,2 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 130:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycji 12 strzykawki 3-częściowej, jałowa, końcówka luer-lock - 20 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 1 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 131:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycji 15 strzykawki trzyczęściowej do insuliny 1 ml, U-100, bezpieczna, z wbudowaną igłą w rozmiarze 29 G 0,33 x 12,5 mm wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt.

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 132:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycji 16 Igły do pena, igłą trójpłaszczyznowa, pokryta powłoką silikonową dla większego komfortu wkłucia, kompatybilne z wstrzykiwaczami do insuliny dostępnymi na rynku zgodnie z normą 11608-2, kodowanie kolorystyczne rozmiaru dla łatwej identyfikacji, sterylizowane tlenkiem etylenu w rozmiarze 0,3x 8mm oraz 0,33x12,5 mm do wyboru Zamawiającego zamiast 0,33x10mm; 0,33x12mm lub 0,33x12,7mm

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 133:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycji 17 przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza stożkowa dwukanalowa, z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne, opakowanie 200 szt.

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 134:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 pozycji 18 Koreczki dwustronne męsko-żeńskie (combi), kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkluc obwodowych, centralnych, tętniczych, kompatybilne z

zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pojedynczo pakowane , , pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierającego np. 50 , 100 lub 200szt, w kolorze czerwonym

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 135:**

**PAKIET 5, pozycja 5,6**

Prosimy o dopuszczenie mat nie będących wyrobem medycznym, a produktem ogólnotowarowym i objętych 23 % stawką podatku VAT.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 136:**

**PAKIET 2, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego standardowego z rękawkami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN IO 811  $\geq 20$ cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1  $\geq 40$ kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3  $\geq 20$ N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 2,9IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10  $\leq 4,0$  log<sub>10</sub>, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1. Fartuch oznaczony w centymetrach: L-123cm, XL – 135cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 137:**

**PAKIET 2, pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego standardowego z rękawkami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN IO 811  $\geq 20$ cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1  $\geq 40$ kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3  $\geq 20$ N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 2,9IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10  $\leq 4,0$  log<sub>10</sub>, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1. Fartuch oznaczony w centymetrach: L-123cm, XL – 135cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.

**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 138:**

**PAKIET 2, pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Ubrania operacyjnego, niesterylnego, nieprzezroczystego, oddychającego wykonane z włókniny SMMS o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> +/- 5%. Dekolt w kształcie litery „V” obszyty białą lamówką. Bluzka z krótkim rękawem i 3 kieszeniami, bez lateksu. Spodnie bez ściągaczy, w pasie na troki. Kolor niebieski. Zgodne z normami EN 13795, EN ISO 13485. **Wytrzymałość na rozciąganie na mokro oraz sucho min. 52 N wg normy EN 29073:3, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 158,2 kPa, mokro 142,1 kPa wg 13938-1.** Pakowane razem w opakowanie foliowe z **instrukcją użytkowania**. Na opakowaniu oznakowanie CE oraz klasy wyrobu medycznego, opis w języku polskim, nazwa producenta, numer katalogowy, numer serii, data ważności, **oznaczenie koloru oraz**

**oznaczenie rozmiaru wraz z długością ubrań podaną w cm. Ubranie posiada metkę z oznaczeniem rozmiaru, producenta oraz numeru katalogowego, dla lepszej identyfikacji produktu. Dostępne w rozmiarach S-3XL.**  
**Odpowiedź.** Nie. Zgodnie z SWZ.

Prezes Zarządu – Wojciech Machelski