



BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
49-301 BRZEG, ul. MOSSORA 1
tel. 77 444 65 75, sekretariat 77 444 65 36,
e-mail: zamowienia.publiczne@bcmbrzeg.pl
REGON: 000 313 437 NIP: 747 15 71 941

PN/1/2025

Brzeg, 28 marca.2025 r.

Do wszystkich
Wykonawców, którzy pobrali
Specyfikację Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „[Dostawa odczynników oraz testów wraz z dzierżawą analizatorów: immunodiagnostycznego i immunoserologicznego na potrzeby Działu Diagnostyki Medycznej Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu](#)” – PN/1/2025.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Zamawiający - Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły w dniach **19.03. 2025 r. – 26.03.2025 r.** do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy zał. Nr 2.1 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy o wyjaśnienie, których kolumn tabeli dotyczy podany wzór w kolumnie "Wartość netto (E*F) ?

Odpowiedź:

Zgodnie z wzorem podanym w kolumnie „Wartość netto” (kolumna G) Wykonawca obliczając wartość netto powinien dokonać działania arytmetycznego polegającego na przemnożeniu ilości opakowań (kolumna E) przez cenę jednostkową netto za opakowanie (kolumna F). W kolumnie wartość netto Zamawiający wskazał na formułę jaka winna być zastosowana do wyliczenia wartości netto (w kolumnie G) w arkuszu kalkulacyjnym excel.

Pytanie nr 2

Dotyczy Zał. nr 2.1 - 2.2 do SWZ- specyfikacje asortymentowo-cenowe pkt.11

Czy Zamawiający dopuści analizator gdzie dozowanie materiału badanego dokonywane jest za pomocą jednorazowych końcówek, a dozowanie odczynników za pomocą igły odczynnikowej, z efektywnym systemem płukania zabezpieczającym przed błędem przeniesienia?


Odpowiedź

*Tak, Zamawiający dopuszcza analizator gdzie dozowanie materiału badanego dokonywane jest za pomocą jednorazowych końcówek, a dozowanie odczynników za pomocą igły odczynnikowej, z efektywnym systemem płukania zabezpieczającym przed błędem przeniesienia. **Patrz zmiana nr 1.** (dotyczy Zał. Nr 2.1 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy)*

Pytanie nr 3

Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu ?

Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczynnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).

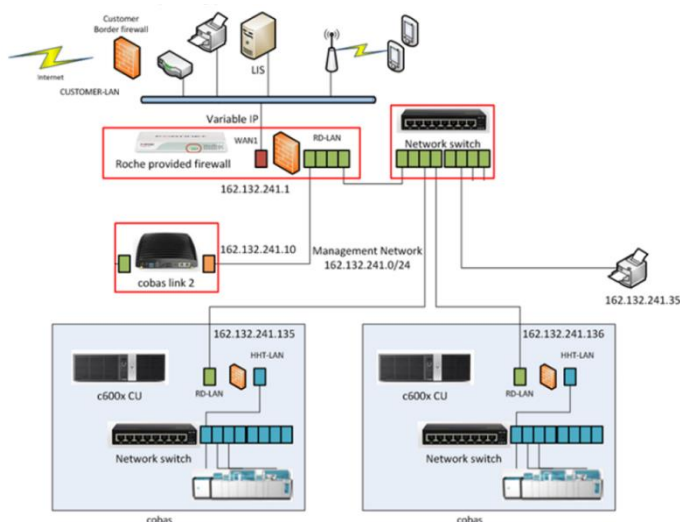

URL	IP	Port	Typ	Description
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navify.com	193.228.103.0/24	433 (514/541)	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
rln-cm-*.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 80	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

Odpowiedź

Tak, Zamawiający zapewnia dostęp do internetu (w celach aktualizacyjnych i serwisowych) na wydzielonych portach określonych przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga jednak, aby urządzenie mogło pracować bez dostępu do internetu przez min. 48 h. Zamawiający wymaga, aby komunikacja z LIS i HIS odbywała się na poziomie sieci lokalnej szpitala.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na długie terminy realizacji podłączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie może zgodzić się na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci do 8 tygodni od daty podpisania umowy, z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości wykonywanych badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Zamawiający powziął informację od dostawcy systemu LIS, że możliwym terminem na podłączenie analizatorów będzie 14 dni. W związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego do 14 dni od daty podpisania umowy. **Patrz zmiana nr 2**

(zmiana dotyczy Zał. Nr 1 do SWZ – formularza oferty, Zał. Nr 10.1 do SWZ – wzór umowy dostawy, Zał. Nr 10.2 do SWZ – wzór umowy dzierżawy, SWZ)

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W pkt 7 ppkt. 3) formularza ofertowego (Zał. Nr 1 do SWZ) Wykonawca może doprecyzować sposób zgłaszania problemów w przypadku reklamacji i może wskazać aplikację Wykonawcy do tego służącą (tj. stronę internetową). W pkt. 9 lit. d) Wykonawca

może wskazać sposób wysłania zamówienia poprzez adres e-mail lub aplikację Wykonawcy do tego służącą. **Patrz zmiana nr 3**
(zmiana dotyczy Zał. Nr 1 do SWZ – formularza oferty, Zał. Nr 10.1 do SWZ – wzór umowy dostawy)

Pytanie nr 6

dotyczy: Zał. nr 2.1 - 2.2 do SWZ- specyfikacje asortymentowo-cenowe

19.	Czas reakcji: od przyjęcie zgłoszenia do podjęcie naprawy - 24 godziny
-----	--

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by wspomniany czas reakcji dotyczył dni roboczych?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Patrz zmiana nr 4.

(zmiana dotyczy Zał. Nr 1 do SWZ – formularza oferty, Zał. Nr 2.1 -2.2 do SWZ – formularza asortymentowo-cenowy)

Załącznik nr 10.1 do SWZ : Wzór umowy dostawy

Pytanie nr 7

par. 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu płatności do 30 dni liczonych od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8

Dotyczy Umowy:

par. 7 ust. 1 pkt 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna była liczona od „niezrealizowanej wartości umowy brutto”? Specyfika realizacji przedmiotu Umowy, polegającego na świadczeniu ciągłym, przez okres ustalony w kontrakcie, czyni nieuzasadnionym naliczanie kar, w stosunku do wartości globalnej umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma uwag do umowy w części wykonanej do daty wypowiedzenia. W przeciwnym razie kara umowna powinna zostać uznana za wygórowaną zgodnie z art. 484 k.c.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany treści umowy w powyższym zakresie. Patrz zmiana nr 5 (zmiana dotyczy Zał. Nr 10.1 do SWZ – wzór umowy dostawy)

Pytanie nr 9

Dotyczy Umowy:

par. 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację limitu kar umownych do „10%”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu umowy w zakresie obniżenia łącznej wysokości kar umownych do 10%.

Pytanie nr 10

Dotyczy Umowy:

par. 7 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odpowiedź:

Z uwagi na to, iż Zamawiającym jest podmiotem leczniczym brak posiadania odpowiednich odczynników uniemożliwia diagnostykę pacjentów, którzy przebywają na oddziale. Z tym wiąże się ponoszenie wymiernych kosztów ich bytności w szpitalu oraz zajmowania łóżka pacjentom, którzy mogą być bardziej potrzebującymi. Kara ma mobilizować wykonawcę do jak najszybszego dostarczenia zamówienia i choć częściowo kompensować straty.

Pytanie nr 11

par. 7 ust. 10

Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Dlatego prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania: „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia

zapłaty całości zaległych należności”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi korelacji pomiędzy brzmieniem §7 ust. 10 umowy a art. 433 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Postanowienie to nie stanowi wykorzystania przewagi kontraktowej, a jest wyrazem konieczności zapewnienia przez szpital ciągłości świadczeń zdrowotnych, co do których szpital jest zobowiązany ustawowo. Ponadto kondycja finansowa szpitala jest na dobrym poziomie. Szpital nie zalega z płatnościami, dlatego zapis proponowany przez Wykonawcę nie znajduje uzasadnienia.

Pytanie nr 12

par. 8 ust. 3 pkt 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu: „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów umowy.

Pytanie nr 13

par. 11 ust. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Załącznik nr 10.2 do SWZ: Wzór umowy dzierżawy

Pytanie nr 14

par. 2 ust. 2 lit. e)

Czy Zamawiający w przypadku przedłużającej się awarii dopuszcza możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Patrz zmiana nr 6. (zmiana dotyczy Zał. Nr 10.2 do SWZ – wzór umowy dzierżawy)

Pytanie nr 15

par. 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu płatności do 30 dni liczonych od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 16

par. 7 ust. 1 pkt 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna była liczona od „niezrealizowanej wartości umowy brutto”? Specyfika realizacji przedmiotu Umowy, polegającego na świadczeniu ciągłym, przez okres ustalony w kontrakcie, czyni nieuzasadnionym naliczanie kar, w stosunku do wartości globalnej umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma uwag do umowy w części wykonanej do daty wypowiedzenia. W przeciwnym razie kara umowna powinna zostać uznana za wygórowaną zgodnie z art. 484 k.c.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany treści umowy w powyższym zakresie. Patrz zmiana nr 8. (zmiana dotyczy Zał. Nr 10.2 do SWZ – wzór umowy dzierżawy)

Pytanie nr 17

par. 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację limitu kar umownych do „10%”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu umowy w zakresie obniżenia łącznej wysokości kar umownych do 10%.

Pytanie nr 18

par. 7 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu "lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

par. 11 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Załącznik nr 10.3 do SWZ – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pytanie nr 20

par. 3 ust. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji postanowień umowy zakazujących przetwarzania danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Tym samym, prosimy o dodanie do niniejszego postanowienia zastrzeżenia: **„Wyjątek stanowią spółki powiązane i podwykonawcy Procesora z listy opisanej załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy. Lista może ulec zmianie, a na propozycję dodania nowych podmiotów Administrator ma prawo nie wyrazić zgody.”**

Uzyskanie zgody na podpowierzenie przetwarzania podwykonawcom, w tym także znajdującym się poza EOG, jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej oraz sprawnej realizacji usługi przez Wykonawcę. Niniejszym, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokładnych informacji na temat podmiotu podprzetwarzającego, który będzie przetwarzał dane.

W przypadku braku zgody, zwracamy się z prośbą o wskazanie, iż Zamawiający będzie korzystał z analizatorów w taki sposób, aby nie wprowadzać do nich danych osobowych.

Wyjaśniamy, że niekiedy występują sytuacje awaryjne, które wymagają zdalnego wsparcia specjalistów z naszych globalnych zespołów serwisowych funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej, znajdujących się poza EOG. Incydentalny, zdalny dostęp do danych przez nasz globalny zespół jest kluczowy dla szybkiego i sprawnego rozwiązywania problemów technicznych, co w konsekwencji minimalizuje potencjalne przestoje i pozwala na utrzymanie wysokiego standardu usług. Pragniemy podkreślić jednocześnie, że takie rozwiązanie nie powoduje agregacji danych osobowych w państwie trzecim, co jest rozwiązaniem bardzo bezpiecznym, szczególnie gdy realizowane jest przez podmiot w ramach grupy kapitałowej, nad którym mamy większą kontrolę i zaufanie.

Wyjaśniamy także, że serwisant spoza EOG uzyska realny, zdalny dostęp do danych wyłącznie wtedy, gdy otrzyma prośbę o wsparcie, a jednocześnie dane osobowe będą umieszczone w analizatorze. Podkreślamy również, że Wykonawca w celu należytego zapewnienia bezpieczeństwa, zapewnia zgodność z wymaganiami oraz zobowiązuje podwykonawców do przestrzegania zasad uregulowanych niniejszą Umową na takich samych warunkach, którym sam podlega. Globalne koncerny podczas świadczenia dostaw lub usług wykorzystują spółki ze swoich grup kapitałowych, co pozwala na korzystanie z unikalnej wiedzy o danym produkcie lub dostępu do tego produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Patrz zmiana nr 9.

Pytanie nr 21

par. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia:

"a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Patrz zmiana nr 10.

Pytanie nr 22

par. 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego zdania: „Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

par. 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy załącznika nr 1 z listą podmiotów podprzetwarzających, w tym na dodanie do Umowy par. 5 ust. 3 o treści **“Lista podmiotów podprzetwarzających znanych na dzień podpisania niniejszej Umowy, z których usług Podmiot przetwarzający jest uprawniony do korzystania, stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.”**?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Patrz zmiana nr 11.

Pytanie nr 24

par. 9 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25

Dotyczy Załącznika nr 2.1 do SWZ, Formularza cenowego – Pakiet nr 2.

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie stawki VAT 23 % dla **pozycji 19** i modyfikację formularza.

Uzasadnienie: Wykonawca informuje, że nie dla wszystkich odczynników, akcesoriów oraz materiałów zużywalnych w pozycji 19 została przewidziana stawka 8% VAT.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Wykonawca może w tej pozycji wymienić zarówno asortyment ze stawką VAT 8% jak i 23%. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany stawki VAT w tej pozycji asortymentowej formularza. (Zał. Nr 2.2 do SWZ). Patrz zmiana 12.

Pytanie nr 26

Dotyczy Załącznika nr 2.1 do SWZ, Formularza cenowego – Pakiet nr 2. Parametry techniczne dla analizatora immunodiagnostycznego. Pkt. 15.

Czy Zamawiający zgodzi się czas reakcji: od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy - 48 godziny i odpowiednio zmiennie zapisy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie. Zamawiający jako podmiot leczniczy musi mieć zapewnioną ciągłość badań laboratoryjnych.

Pytanie nr 27

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, Formularza ofertowego, pkt 6. Okres przydatności do zużycia, pkt 1), wzoru umowy dostawy, § 1, ust. 5 i § 6, ust. 2 oraz Parametrów technicznych dla analizatora immunodiagnostycznego, pkt 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z następującymi terminami ważności:

- Pozycja 9 FC – minimum 5 miesięcy
- Pozycja 11 FC – minimum 4 miesiące
- Pozycja 19 FC - minimum 4 miesiące
- Dla pozostałych pozycji termin ważności będzie zgodny z SWZ Zamawiającego

Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca nie ma prawa gwarantować okresu ważności dłuższego niż zalecany przez producenta. Brak zgody Zamawiającego na powyższe terminy uniemożliwi Wykonawcy złożenie wiążącej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników w poz. 9 i poz. 11 Zał. Nr 2.2 do SWZ z terminem ważności wynoszącym odpowiednio dla poz. 9 – min. 5 miesięcy, dla poz. 11 – min. 4 miesiące. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu ważności odczynników i innych akcesoriów w poz. 19.

Zamawiający informuje, że dokona odpowiedniej zmiany w powyższym zakresie w Zał. Nr 1 do SWZ – formularz oferty i Zał. Nr 2.2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy i w Zał. Nr 10.1 do SWZ – projektowanych postanowieniach umowy. Patrz zmiana nr 13.

Pytania do wzoru umowy dostawy (Załącznika nr 10.1 do SWZ):

Pytanie nr 28

§5 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostawę artykułów w terminie do 60 dni liczonych od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT przy każdorazowej dostawie **lub w formie elektronicznej w sposób wskazany w §5 ust. 5 Umowy**”?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany w powyższym zakresie. *Patrz zmiana nr 15.*

Pytanie nr 29

§7 ust. 1 pkt 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 3,5% wartości niedostarczonych produktów brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy?

Uzasadnienie: Zaproponowana kara posiada przymiot kary rażąco wygórowanej i jako taka zgodnie z przepisami KC może podlegać miarkowaniu przez Sąd. Standardowo stosowanymi karami w tego rodzaju postępowaniach są kary na poziomie 0,1% - 2% wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i obniżenie wysokości zaproponowanej kary.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych.

Pytanie nr 30

§7 ust. 6 –

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku wad odczynników laboratoryjnych objętych przedmiotem umowy stwierdzonych przy każdorazowej dostawie lub dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany artykułów na pozbawione wad, nie później niż w ciągu 72 godzin od uwzględnienia reklamacji, przy czym ponowna dostawa nastąpi w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach od 7:30 do 14:00 loco Laboratorium Zamawiającego”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów umowy.

Pytanie nr 31

§7 ust. 10 –

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku opóźnienia płatności o mniej niż 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2 umowy , Wykonawca nie ma prawa do wstrzymania każdorazowych dostaw przedmiotu umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów umowy.

Pytania do wzoru umowy dzierżawy (Załącznika nr 10.2 do SWZ):

Pytanie nr 32

§2 ust. 2 lit . c –

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „usunięcia usterki lub awarii w okresie do 72 godzin w dni robocze. Czas ten rozumie się jako czas od zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu, przy czym czas reakcji na podjęcie naprawy wynosi do 48 godzin w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia. Strony po uprzednim uzgodnieniu dopuszczają możliwość wydłużenia terminu przeznaczonego na usunięcie usterki lub awarii w razie wyjątkowego skomplikowania powstałej wady lub usterki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów umowy, ze względu na konieczność ciągłego wykonywania badań dla Oddziałów Brzeskiego Centrum Medycznego.

Pytanie nr 33

§2 ust. 2 lit . e –

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „sprzętu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 72 godziny w dni robocze”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów umowy.

Pytanie nr 34

§7 ust. 1 pkt 2 –

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „w wysokości 0,5% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu umowy w powyższym zakresie. Zapis umowy w aktualnym brzmieniu jest korzystniejszy dla Wykonawcy (Wydierżawiającego), bowiem Wydierżawiający zapłaci Zamawiającemu (Dzierżawcy) kary umowne w wysokości 0,5% łącznej wartości przedmiotu umowy netto, w przypadkach o których mowa w pkt. 2 lit. a) i b), a nie 0,5% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, jak wskazuje Wykonawca.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego, niezbędnego dla zapewnienia kompleksowego wsparcia technicznego zainstalowanej aparatury, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, zdalną diagnostykę usterek, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oraz udzielanie szybkiej zdalnej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora:

„Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, zdalnej diagnostyki usterek, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych” lub przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania w formie odrębnej umowy lub oświadczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany do zapisów umowy. Patrz zmiana nr 17.

Pytanie nr 36

Dotyczy Zał. nr 2.1 do SWZ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, czy omyłkowo w pozycji 6. dla parametru TPSA w kolumnie „Ilość opakowań (uwzględniająca ilość oznaczeń w okresie 32 miesięcy)” – nie zostało wpisane 7 zamiast 70 opakowań ? Ilość oznaczeń w okresie 32 m-cy wynosi 7000 (wielkość opakowania odczynnika to 100 oznaczeń).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w poz. 6 dla parametru TPSA w kolumnie „ilość opakowań” omyłkowo wpisał 7 zamiast 70 opakowań. Zamawiający dokona poprawienia ilości opakowań w Zał. Nr 2.1 do SWZ w tej pozycji asortymentowej. Patrz zmiana nr 16.

II. ZMIANY TREŚCI SWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) dokonuje następujących zmian treści SWZ:

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 2):

Zamawiający w formularzu asortymentowo-cenowym dla Pakietu nr 1 w pkt. 11 PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA ANALIZATORA IMMUNODIAGNOSTYCZNEGO (Załącznik Nr 2.1 do SWZ) dokonuje zmiany zapisu z:

„Jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników”

na następujący:

„Jednorazowe końcówki do pipetowania odczynników. Igła odczynnikowa z efektywnym systemem płukania zabezpieczającym przed błędem przeniesienia.”

Zmiana nr 2 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 4):

Zamawiający w Dziale VI pkt. 4 SWZ dokonuje zmiany w zakresie wydłużenia terminu protokolarnego przekazania analizatorów z: 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na: 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Jednocześnie zmianie ulega:

- zapis § 3 ust. 1 wzoru umowy dzierżawy (Załącznik Nr 10.2 do SWZ) z:**

„Strony wspólnie uzgadniają, że Wydzierżawiający wyda Dzierżawcy urządzenia objęte przedmiotem umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy w siedzibie Dzierżawcy przy ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg.”

na następujący:

„Strony wspólnie uzgadniają, że Wydzierżawiający wyda Dzierżawcy urządzenia objęte przedmiotem umowy w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia podpisania niniejszej umowy w siedzibie Dzierżawcy przy ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg;”

• **zapis pkt. 5 ppkt.2) formularza oferty (Zał. Nr 1 do SWZ) z:**

“Termin protokolarnego dostarczenia, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu analizatora/-ów: **do 10 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy.”

na następujący:

“Termin protokolarnego dostarczenia, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu analizatora/-ów: **do 14 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy.”

Zmiana nr 3 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 5):

- 1) Zamawiający w formularzu oferty (Zał. Nr 1 do SWZ) dokonuje zmiany poprzez wprowadzenie pkt. **7 REKLAMACJE, USUNIĘCIA USTEREK I AWARII**. Wskutek wprowadzenia pkt. 7 do formularza ofertowego zmiana ulega numeracja kolejnych punktów formularza.

W pkt 7 ppkt. 3) formularza ofertowego (Zał. Nr 1 do SWZ) Wykonawca może doprecyzować sposób zgłaszania problemów w przypadku reklamacji i może wskazać aplikację Wykonawcy do tego służącą (tj. stronę internetową).

W pkt. 9 lit. d) Wykonawca może wskazać sposób wysłania zamówienia poprzez adres e-mail lub aplikację Wykonawcy do tego służącą.

- 2) Jednocześnie zmianie ulega § 1 ust. 3 wzoru umowy na dostawy (Zał. Nr 10.1 do SWZ) z:

„Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy odczynników laboratoryjnych w pozycjach i ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, po uprzednim wysłaniu zamówienia w formie dokumentu elektronicznego doręzonego na adres e-mail:, w ciągu dni roboczych od momentu zgłoszenia zamówienia w godzinach od **7:30 do 14:00, loco Laboratorium** Zamawiającego pod adresem 49-301 Brzeg, ul Mossora 1. Wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 200,00 zł netto.”

na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy odczynników laboratoryjnych w pozycjach i ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, po uprzednim wysłaniu zamówienia w formie dokumentu elektronicznego doręzonego na adres e-mail:, **lub aplikację Wykonawcy do tego służącą**w ciągu dni roboczych od momentu zgłoszenia zamówienia w godzinach od **7:30 do 14:00, loco Laboratorium** Zamawiającego pod adresem 49-301 Brzeg, ul Mossora 1. Wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 200,00 zł netto.”

Zmiana nr 4 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 6):

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie Zał. Nr 2.1 do 2.2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy poprzez doszczegółowienie czasu reakcji od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy wskazanego **w pkt. 19 Zał. nr 2.1 do SWZ oraz w pkt. 15 Zał. Nr 2.2 do SWZ**.

- 1) W pkt. 19 Zał. Nr 2.1 do SWZ jest:

19.	Czas reakcji: od przyjęcie zgłoszenia do podjęcie naprawy - 24 godziny
-----	--

po zmianie winno być:

19.	Czas reakcji: od przyjęcie zgłoszenia do podjęcie naprawy - 24 godziny w dni robocze
-----	---

- 2) W pkt. 15 Zał. Nr 2.2 do SWZ jest:

15.	Czas reakcji: od przyjęcie zgłoszenia do podjęcie naprawy - 24 godziny
-----	--

po zmianie winno być:

15.	Czas reakcji: od przyjęcie zgłoszenia do podjęcie naprawy - 24 godziny w dni robocze
-----	---

3) W Zał. Nr 1 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy Zamawiający wprowadza pkt. 7 REKLAMACJE, USUNIĘCIA USTEREK I AWARII o następującej treści:

“7. REKLAMACJE, USUNIĘCIA USTEREK I AWARII.

- 1) Reklamacje odczynników będą załatwiane w terminie **(nie dłuższym niż 72 godziny)**: od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego o zaistniałym fakcie, przy czym ponowna dostawa nastąpi w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach od 7:30 do 14:00 **loco Laboratorium Zamawiającego**.
- 2) Zgłaszanie usunięcia usterki lub awarii dzierżawionego sprzętu będzie załatwiane w terminie do 48 godzin w dni robocze. Czas ten rozumie się jako czas od zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu, **przy czym czas reakcji na podjęcie naprawy wynosi do 24 godzin w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia.**
- 3) Sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji :

Zmiana nr 5 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 8):

W § 7 ust. 1 pkt 1) Zał. Nr 10.1 do SWZ – projektowane postanowienia umowy Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisu z :

„1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- 1) z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10,00% łącznej wartości przedmiotu umowy netto określonej w postanowieniu § 2 ust. 1;”

na następujący:

„1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- 1) z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10,00% **niezrealizowanej** wartości przedmiotu umowy netto określonej w postanowieniu § 2 ust. 1;”

Zmiana nr 6 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 14):

Zamawiający w § 2 ust. 2 Zał. Nr 10.2 do SWZ (Wzór umowy dzierżawy) dokonuje zmiany polegającej na dodaniu zapisu w następującym brzmieniu:

„f) wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wydierżawiającego w przypadku przedłużającej się awarii pow. 48 godzin.”

Zmiana nr 7

W Zał. Nr 2.2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy, w **poz. 14 - PARAMETRY TECHNICZNE DLA ANALIZATORA IMMUNOSEROLOGICZNEGO**, Zamawiający dokonuje zmiany zapisu poprzez ujednolicenie zapisu z poz. 14 do treści § 2 pkt. 2 lit. e) Zał. Nr 10.2 do SWZ – wzór umowy dzierżawy.

Nowy zapis w poz. 14 Zał. Nr 2.2 do SWZ otrzymuje brzmienie:

„Dostarczenie aparatu zastępczego w przypadku awarii lub naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 48 godzin w dni robocze.”

Zmiana nr 8 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 16):

W § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy dzierżawy (Zał. Nr 10.2 do SWZ) Zamawiający dokonuje zmiany zapisu z:

„Wydierżawiający zobowiązuje się zapłacić Dzierżawcy kary umowne:

- 1) z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wydierżawiający ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10,00% łącznej wartości przedmiotu umowy netto”

na następujący:

„Wydierżawiający zobowiązuje się zapłacić Dzierżawcy kary umowne:

- 1) z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wydierżawiający ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10,00% **niezrealizowanej** wartości przedmiotu umowy netto”

Jednocześnie zmianie ulega zapis § 7 ust. 3 umowy dzierżawy z :

„Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić Wydierżawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Dzierżawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10,00% łącznej wartości przedmiotu umowy netto, za wyjątkiem przypadków określonych w umowie oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.”

na następujący:

„Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić Wydierżawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Dzierżawca ponosi odpowiedzialność, **w wysokości 10,00% niezrealizowanej wartości** przedmiotu umowy netto, za wyjątkiem przypadków określonych w umowie oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.”

Zmiana nr 9 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 20):

W §3 ust. 2 Zał. Nr 10.3 do SWZ - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisu z:

„2. Jeżeli powierzone dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach i nośnikach danych Procesora, te serwery i nośniki nie mogą znajdować się poza obszarem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.”

na następujący:

„2. Jeżeli powierzone dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach i nośnikach danych Procesora, te serwery i nośniki nie mogą znajdować się poza obszarem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. **Wyjątek stanowią spółki powiązane i podwykonawcy Procesora z listy opisanej załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy. Lista może ulec zmianie, a na propozycję dodania nowych podmiotów Administrator ma prawo nie wyrazić zgody.**”

Zmiana nr 10 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 21):

Zamawiający w § 4 ust. 1 Zał. Nr 10.3 do SWZ – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych **osobowych**, dokonuje zmiany treści poprzez dodanie w ust. 1 następujących podpunktów:

- “a) Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Administratora danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Procesora, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Procesora środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.**
- b) Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Procesora.**
- c) Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Procesora.**
- d) Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Procesora, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Procesora.”**

Zmiana nr 11 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 23):

W §5 Zał. Nr 10.3 do SWZ - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający dokonuje dopisania punktu 3 w następującym brzmieniu:

“3. Lista podmiotów podprzetwarzających znanych na dzień podpisania niniejszej Umowy, z których usług Podmiot przetwarzający jest uprawniony do korzystania, stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.”

Zmiana nr 12 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 25):

Zamawiający w formularzu asortymentowo – cenowym dla Pakietu nr 2 w poz. 19 dokonuje zmiany wskazanej tam stawki VAT 8% na stawkę „8% i 23%”. Wykonawca może w tej pozycji wymienić zarówno asortyment ze stawką VAT 8% jak i 23%.

Zmiana nr 13 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 27):

- 1) W pkt. 6 – OKRES PRZYDATNOŚCI ODCZYNNIKÓW Zał. Nr 1 do SWZ – formularz oferty, Zamawiający dokonuje następującej zmiany zapisu :**

Jest:

Termin ważności odczynników wynosi min. 6 miesięcy liczonych od dnia faktycznego dostarczenia Zamawiającemu asortymentu.

Po dokonanej zmianie winno być:

Termin ważności odczynników wynosi min. 6 miesięcy liczonych od dnia faktycznego dostarczenia Zamawiającemu asortymentu, za wyjątkiem poz. 9 i poz. 11 Zał. Nr 2.2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 2), gdzie termin ważności wynosić winien odpowiednio;:

- a) dla poz. 9 – minimum 5 miesięcy;*
- b) dla poz. 11 – minimum 4 miesiące*

- 2) W pkt. 4 PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA ANALIZATORA IMMUNOSEROLOGICZNEGO – Zał. Nr 2.2 do SWZ, Zamawiający dokonuje następującej zmiany zapisu:**

Jest:

Oznaczenie na zasadzie monotestu. Trwałość odczynników po otwarciu opakowania nie krótsza niż podana na opakowaniu jako termin ważności (minimum 6 miesięcy). Co najmniej cztery niezależne sekcje pomiarowe

Po dokonanej zmianie winno być:

Oznaczenie na zasadzie monotestu. Trwałość odczynników po otwarciu opakowania nie krótsza niż podana na opakowaniu jako termin ważności (minimum 6 miesięcy, **a dla poz. 9 - minimum 5 miesięcy, a dla poz. 11 - minimum 4 miesiące**). Co najmniej cztery niezależne sekcje pomiarowe

- 3) W § 6 ust. 2 Zał. Nr 10.1 do SWZ – projektowane postanowienia umowy na dostawy, Zamawiający dokonuje następującej zmiany zapisu treści z:**

„Termin gwarancji odczynników wynosi **przynajmniej 6 miesięcy** liczonych od dnia faktycznego dostarczenia Zamawiającemu.”

na następującą:

„Termin gwarancji odczynników wynosi **przynajmniej 6 miesięcy** liczonych od dnia faktycznego dostarczenia Zamawiającemu, **za wyjątkiem toxoplazmozy Ig G dla której termin gwarancji wynosi przynajmniej 5 miesięcy i RUB IgM dla którego termin gwarancji wynosi minimum 4 miesiące.**”

Zmiana nr 14

Zamawiający w Zał. Nr 2.2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy dokonuje zmiany **omyłkowo** podanej nazwy analizatora.

W formularzu asortymentowo-cenowym w Zał. Nr 2.2 do SWZ jest:
PARAMETRY TECHNICZNE DLA ANALIZATORA IMMUNODIAGNOSTYCZNEGO

Po dokonanej zmianie winno być:

PARAMETRY TECHNICZNE DLA ANALIZATORA IMMUNOSEROLOGICZNEGO.

Zmiana nr 15 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 28):

W §5 ust. 2 Zał. Nr 10.1 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisu z:

„2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostawę artykułów w terminie do 60 dni liczonych od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT przy każdorazowej dostawie.”

na następujący:

*„2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostawę artykułów w terminie do 60 dni liczonych od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT przy każdorazowej dostawie **lub w formie elektronicznej w sposób wskazany w §5 ust. 5 niniejszej umowy.**”*

Zmiana nr 16 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 35):

W §2 wzoru umowy dzierżawy (Zał. Nr 10.2 do SWZ), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści zapisu w ust. 2 lit. b) poprzez dodanie następującego zapisu:

*„b) w ramach czynszu dzierżawnego serwisu gwarancyjnego/technicznego w czasie trwania umowy dzierżawy. **Serwis analizatora w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, zdalnej diagnostyki usterek, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Dzierżawca umożliwi Wydzierżawiającemu dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych;**”*

Zmiana nr 17 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 36):

Zamawiający dokonuje poprawienie ilości opakowań, które omyłkowo wpisał dla parametru TPSA w poz. 6 formularza asortymentowo-cenowego dla Pakietu nr 1 (Zał. Nr 2.1 do SWZ).

W poz. 6 w “Ilość opakowań (uwzględniająca ilość oznaczeń w okresie 32 miesięcy)” jest 7 opakowań, a winno być: 70 opakowań.

Zmiana nr 18

W Zał. Nr 2.1 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy, w poz. 22 – Zamawiający dokonuje zmiany treści przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację z dzierżawy wskazanego w poz. 22 zestawu komputerowego all in one (o parametrach nie gorszych niż :Procesor I5, min. 16 GB RAM, dysk SSD nie mniejszy niż 200 GB z możliwością wpięcia do domeny Brzeskiego Centrum Medycznego. lub równoważny).

W wyniku usunięcia całkowicie poz. 22, **zmienia się numeracja kolejnych punktów** odnoszących się do tabeli PARAMETRY TECHNICZNE DLA ANALIZATORA IMMUNODIAGNOSTYCZNEGO.

Zamawiający informuje, że **zmieniona SWZ wraz z zmodyfikowanymi Załącznikami: Zał. Nr 1 do SWZ – Formularzem oferty, Zał. Nr 2.1- 2.2 do SWZ – formularzami asortymentowo-cenowymi, Zał. Nr 10.1 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, Zał. Nr 10.2 do SWZ – wzór umowy dzierżawy, Zał. Nr 10.3 do SWZ – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych**, zostanie opublikowana na stronie prowadzonego postępowania: <https://e-ProPublico.pl/> w zakładce: **Dokumenty zamówienia**. Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje, jako **stanowiące integralną część SWZ**.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 oraz 137 ust. 2 ustawy Pzp stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

.....
Kierownik Zamawiającego